



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI - <http://www.tre-pi.jus.br>

PROCESSO : 0010587-30.2023.6.18.8000
INTERESSADO : @interessados_quebra_linha_maiusculas@
ASSUNTO : PARECER TÉCNICO GRUPO 5

Parecer nº 686 / 2024 - TRE/PRESI/DG/SGP/SAS

PARECER TÉCNICO Nº 01/2024 - ANÁLISE DA PROPOSTA DA EMPRESA VERSA DENTAL E MED LTDA

Este parecer visa a análise técnica da proposta da empresa VERSA DENTAL E MED LTDA para o grupo 5, a fim de avaliar a conformidade com as especificações constantes no instrumento convocatório nº 90006/2024 (0002025181).

Da análise da proposta, entende-se que o item 90, embora atenda à especificação constante no Edital, foi observado sobrepreço para a silicona de modelos **da marca Yller**, cujo valor gira em torno de R\$ 180,00, o que representa 2,3 vezes maior que o valor unitário apresentado na proposta.

Os demais itens atendem às especificações constantes no Edital.

É o parecer

CELEYDA GETSÊMANE MARTINS GUIMARÃES MOTTA
ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/ODONTOLOGIA



Documento assinado eletronicamente por **Celeyda Getsemane Martins Guimarães Motta**, Analista Judiciário, em 13/03/2024, às 13:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002036117** e o código CRC **370EE90F**.



--



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira, nº 80 - Bairro Cabral - CEP 64000920 - Teresina - PI - <http://www.tre-pi.jus.br>

PROCESSO : 0010587-30.2023.6.18.8000
INTERESSADO : SHOP ODONTO DENTAL
ASSUNTO : PARECER TÉCNICO GRUPOS 1,2,3,4,6 E 7

Parecer nº 718 / 2024 - TRE/PRESI/DG/SGP/SAS

PARECER TÉCNICO Nº 01/2024 - ANÁLISE DA PROPOSTA DA EMPRESA SHOP ODONTO DENTAL

1. INTRODUÇÃO

Este parecer visa à análise técnica da proposta da empresa SHOP odonto dental para o grupos 1,2 ,3 ,4 ,6 e 7, a fim de avaliar a conformidade com as **especificações constantes no instrumento convocatório nº 90006/2024 (0002025181)** e a **compatibilidade entre os preços de mercado das marcas apresentadas nas propostas**, tendo em vista a grande disponibilidade de produtos odontológicos com diversas especificações, valores e qualidade.

2. ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS

Da análise da proposta, seguem os seguintes esclarecimentos:

GRUPO 1

As propostas do Grupo 1 atendem às especificações constantes no Edital e os preços das marcas apresentadas estão compatíveis com o preço estimado.

GRUPOS 2 E 3

As propostas do Grupo 2 **não atendem às especificações** da maioria dos itens ou apresentam preços superiores ao de mercado para a marca, conforme apresenta a tabela abaixo:

Tabela 1: análise técnica da especificação e preço de mercado da marca.

GRUPO	ITENS	ANÁLISE TÉCNICA
2	13	Atende às especificações Preços das marcas apresentadas compatíveis com o preço estimado
2	14	Não atende á especificação.

		A marca KERR apresentada não possui sistema adesivo AUTOCONDICIONANTE, conforme pode ser visto no endereço eletrônico do fabricante https://kerrdental.com.br/produtos/ . O fabricante possui apenas adesivo universal, adesivo de 3 passos em frascos separados (correspondente ao item 15) e um adesivo simplificado de frasco único. Importante a conferência da especificação do Edital e da marca de referência para a devida apresentação das propostas.
2	15	Atende à especificação do edital e possui preço compatível com o valor de mercado para a marca apresentada.
2	16	A resina FLOW da marca biodinâmica não atende à especificação, pois a quantidade de carga é mínima e não atinge o necessário para realização do Resin Coating, etapa indispensável para a técnica restauradora biomimética (mínimo de 80%), conforme pode ser visto na bula do produto em documento anexo e descrito no Edital. Além da especificação, o valor do produto no mercado, conforme pesquisa em sítios especializados como a Dental Cremer e Dental Speed, custa em torno de R\$ 28,90 a seringa (kit com 3 seringas R\$ 86,90), apresentando um preço expressivamente superior na proposta de R\$ 275,00.
2	17	Cimento resinoso dual em Clicker com 4,5g. A proposta apresenta produto da marca MAQUIRA, Cimento Dual Force, com o valor de mercado dessa marca em torno de 89,90 (Dental Cremer), expressivamente inferior ao valor apresentado pela empresa na proposta (R\$285,00).
2	18 ao 24	Proposta não atende à especificação por apresentar carga de 15,8 MICRÔMETROS, superior à carga especificada de até 5 NANÔMETROS. O maior preço da resina Zircofill / marca Maquira encontrado para a marca foi de R\$ 51,99 superior ao valor da proposta (R\$ 278,00).
2	25 ao 28	Proposta não atende à especificação por não ser 100% nanométrica, mas nanohíbrida. O maior preço da resina Zircofill / marca Maquira encontrado para a marca foi de R\$ 51,99 superior ao valor da proposta (R\$ 278,00).

2	29	Manual do fabricante não faz referência ao tipo e ao tamanho das partículas (se nanométricas, microparticulada ou híbrida), impossibilitando a análise.
2	30	Proposta não atende à especificação. Apresenta produto em frasco único e não primer e ativador em frascos separados , como descrito em edital. A exigência dos frascos separados deve-se à rápida reação do primer e ativador, quando em frasco único, acelerando a reação dentro do frasco e reduzindo a vida útil do produto.
2	31	Proposta atende à especificação.
2	32	Proposta atende à especificação.
2	33	Proposta atende à especificação
2	34	Proposta atende à especificação
2	35	Proposta não atende à especificação Fio retrator apresentado na proposta não é tricotado ou entrelaçado, mas trançado simples. O fio tricotado ou entrelaçado permite maior absorção da solução hemostática, melhor adaptação e controle do fluido crevicular. Valor de mercado para a marca: R\$ 24,90 Valor da proposta: R\$ 81,00
2	36	Proposta não atende à especificação Fio retrator apresentado na proposta não é tricotado ou entrelaçado, mas trançado simples. O fio tricotado ou entrelaçado permite maior absorção do hemostático, melhor adaptação e controle do fluido crevicular. Valor de mercado para a marca: R\$ 24,90 Valor da proposta: R\$ 85,00

Tabela 2: análise técnica da especificação e preço de mercado da marca.

GRUPO	ITENS	ANÁLISE TÉCNICA
3	37 A 47	Proposta atende à especificação.
3	48	Proposta NÃO atende à especificação. Conforme os produtos disponíveis no endereço eletrônico do fabricante SHOFU , não há disco enborrachado espiral DESSA MARCA .

3	49 e 50	Proposta NÃO atende à especificação. Conforme os produtos disponíveis no endereço eletrônico do fabricante SHOFU, não há discos EQUIVALENTES AOS DA SÉRIE LARANJA pop-on .Os discos da marca em análise são fixos e não permitem a mudança do lado abrasivo para adaptação às diferentes faces dos dentes.
3	51, 52, 53	Proposta atende à especificação.
3	54	Dique do borracha MK Life, embora atenda à especificação custa em torno de R\$ 59,00, conforme pesquisa no site do fabricante no endereço eletrônico https://www.mklife.com.br/lencol-de-borracha.html <u>Preço de mercado da marca: R\$ 59,00</u> <u>Preço da proposta: R\$ 134,00</u>
3	55, 56	Proposta atende à especificação.
3	57	Proposta não indica a marca, impossibilitando análise da especificação, indicou apenas o site Dental Cremer no campo referente à marca.
3	58 e 59	<u>Valor de mercado da matriz marca Preven: R\$ 1,79</u> <u>Valor da proposta: 34,95</u> Além do valor expressivamente superior ao da marca, foi identificado que não possui de comprimento, como especificado, Caso haja dessa marca matriz com esse comprimento, há necessidade de apresentação da amostra, conforme item 7.3 do edital para avaliação dos critérios objetivos de qualidade requeridos.
3	60	<u>Valor de mercado do mandril marca Preven: R\$ 3,49</u> <u>Valor da proposta: 157,24</u> Proposta NÃO atende à especificação, tendo em vista haver exigência em Edital que seja de marca compatível à marca aparentada para o item 50.
3	61	<u>Valor de mercado da matriz pre-contornada marca Preven: R\$ 89,00</u> <u>Valor da proposta: 195,00</u>

		Além do sobrepreço identificado, necessita de amostra, conforme item 7.3 do edital para avaliação dos critérios objetivos de qualidade requeridos.
3	62	Barreira gengival marca AAF do Brasil <u>Valor de mercado : R\$ 13,00</u> <u>Valor da proposta: 47,42</u>
3	63	Proposta ATENDE à especificação e possui preço compatível com o da marca.
3	64 E 65	<u>Valor de mercado : R\$ 13,90</u> <u>Valor da proposta: 59,52</u> Além do sobrepreço identificado, necessita de amostra, conforme item 7.3 do edital para avaliação dos critérios objetivos de qualidade requeridos.
3	66 a 69	Atendem à especificação e preço compatível com mercado
3	70	<u>Valor de mercado : R\$ 5,24</u> <u>Valor da proposta: 15,00</u> Embora atenda Às especificações do edital apresenta sobrepreço.
3	71 a 76	Atendem à especificação e preço compatível da marca no mercado.
GRUPO 4		
4	77 a 85	Atendem à especificação e preço compatível da marca no mercado.
4	86	Necessita de apresentação de amostra, conforme item 7.3 do edital para avaliação dos critérios objetivos de qualidade requeridos.
4	87 e 88	Atendem à especificação e preço compatível da marca no mercado.
GRUPO 6		
6	112 a 118	Atendem à especificação e preço compatível da marca no mercado.
6	119	Não foi encontrado no site do fabricante FAVA o espelho clínico nº 10 . https://www.fava.com.br/produtos_inox.html

6	120 a 125	Atendem à especificação e preço compatível da marca no mercado.
GRUPO 7		
7	126	Atende à especificação e preço compatível da marca no mercado.
7	127	Não há pó de GLICINA disponibilizado pela marca MAQUIRA, mas pó de bicarbonato de sódio para profilaxia, o qual não atende à especificação.
7	128 e 129	Atendem à especificação e preço compatível da marca no mercado.
7	130	Não há pó de óxido de ALUMÍNIO 50 MÍCRONS disponibilizado pela marca MAQUIRA, mas pó de bicarbonato de sódio para profilaxia, o qual não atende à especificação. O pó de óxido de alumínio é utilizado para jatear cavidades dentárias e criar micro-retenções, em jato de óxido de alumínio, próprio para tal finalidade.
7	131	Não há ponta misturadora disponibilizada pela marca FAVA, portanto não podem ser aferidas as características especificadas em edital, nem o preço de mercado da marca em análise.
7	132 e 133	Atendem à especificação e preço compatível da marca no mercado.

3. CONCLUSÃO

Após minuciosa análise deste Regional, das características dos materiais odontológicos e dos valores correspondentes às marcas apresentados na proposta realizada pela Cirurgiã-Dentista ocupante do cargo de Analista Judiciário - Apoio especializado-Odontologia, foram obtidas as seguintes conclusões:

Grupo 1: ATENDEM às especificações do Edital e apresentam preços compatíveis com o valor de mercado da marca da marca apresentada na proposta.

Grupos 2 e 3: NÃO ATENDEM às especificações do Edital OU apresentam sobrepreço, conforme tabelas 1 e 2.

Grupo 4: Necessita da apresentação de amostra do item 86 para análise dos requisitos objetivos descritos no item 7 do Edital. Os demais itens atendem às especificações do Edital e apresentam preços compatíveis com o valor de mercado das marcas apresentadas na proposta.

Grupo 6: O item 119 não foi identificado no catálogo de produtos da FAVA ([CATÁLOGO FAVA](#)) ou em qualquer sítio especializado em materiais odontológicos o espelho clínico nº 10, impossibilitando análise da especificação e preço de mercado

Os demais itens atendem às especificações do Edital e apresentam preços compatíveis com o valor de mercado da marca da marca apresentada na proposta.

Grupo 7: Os itens 127, 130 e 131 não são comercializados pela marca constante na proposta. Os demais itens atendem às especificações do Edital e apresentam preços compatíveis com o valor de mercado da marca da marca apresentada na proposta.

Todas as especificações e valores encontrados em sítios especializados na internet encontram-se em anexo. Vale ressaltar que produtos de algumas marcas não possuem estudos randomizados ou revisões sistemáticas comprovando o desempenho e características apresentadas pela empresa, de modo que alguns fabricantes ofertam seus produtos a preços expressivamente inferiores ao de marcas já estudadas e com desempenho clínico comprovados.

É o parecer.

CELEYDA GETSÊMANE MARTINS GUIMARÃES MOTTA

ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/ODONTOLOGIA



Documento assinado eletronicamente por **Celeyda Getsemane Martins Guimarães Motta**, Analista Judiciário, em 18/03/2024, às 09:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002039816** e o código CRC **8B363565**.

0010587-30.2023.6.18.8000

0002039816v44



--

QUALIDADE, INOVAÇÃO E
A MAIOR VARIEDADE DE PRODUTOS.



ODONTO



MILLENIUM



ALUMÍNIO



HOSPITAL



PLÁSTICO



PONTAS



ACABAMENTOS



ESTOJOS



DESCARTÁVEIS

Catálogo Geral

 /favaindustria  /favaindustrias

ÍNDICE

03
DBI PRF



04
Odonto



08
Millenium



13
Descartáveis



10
Hospital



12
Plástico



14
Pontas
Diamantadas




Estojo Double 18x8x3 CM Oblongo

- 100DBI Estojo Double 18 X 08 X 05 Cm - Oblongo
- 101DBI Estojo Double 20 X 10 X 05 Cm - Oblongo
- 102DBI Estojo Double 26 X 12 X 06 Cm - Oblongo
- 103DBI Estojo Double 28 X 14 X 06 Cm - Oblongo
- 104DBI Estojo Double 32 X 16 X 08 Cm - Oblongo
- 105DBI Estojo Double 36 X 22 X 09 Cm - Oblongo
- 107DBI Estojo Double 42 X 18 X 09 Cm - Oblongo
- 108DBI Estojo Double 42 X 28 X 12 Cm - Oblongo
- 110DBI Estojo Double 20 X 11 X 04 Cm P/Perio 14 Instr. - Oblongo
- 111DBI Estojo Double 18 X 08 X 03 Cm - Oblongo
- 180DBI Estojo Double 8,5 X 05 X 2,2 Cm P/ 12 Pontas Pm Em Inox - Oblongo
- 190DBI Estojo Double 8,5 X 3,2 X 2,2 Cm P/12 Pontas Fg/Ca Em Inox - Oblongo



Estojo DBI

- 110 DBI Caixa Inox para 14 instrumentais de periodontia

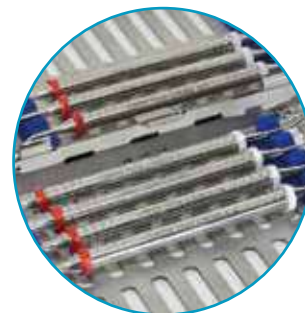

Estojo PRF

- Estojo de Inox PRF



Broqueiro DBI

- 180 DBI Broqueiro 12 pontas PM / Cirúrgica
- 190 DBI Broqueiro 12 pontas FG/CA



Odonto

Estojo * Estuche * Case

- 06 x 3,5 x 3,5 cm
- 7 x 6 x 3 cm
- 7 x 6 x 3 cm para 30 pontas/fresas/burs
- 7 x 6 x 5 cm
- 7 x 6 x 5 cm com 30 pontas/fresas/burs(PM)
- 8 x 8 x 3 cm
- 9 X 9 X 3 cm
- 10 x 10 X 3 cm
- 12 x 5 x 2 cm
- 12 x 9 x 3 cm
- 18 x 4 x 3 cm
- 18 x 7 x 2 cm
- 18 x 8 x 2 cm
- 18 x 8 x 3 cm
- 18 x 8 x 5 cm
- 19 x 10,5 x 2 cm com manta de silicone/sílica
- 20 x 10 x 2 cm
- 20 x 10 x 3 cm
- 20 x 10 x 5 cm
- 21,5 x 15 x 7 cm mod.Professor Machado
- 22,5 x 10,5 x 3 cm
- 26 x 12 x 6 cm
- 28 x 14 x 6 cm
- 32 x 16 x 8 cm

- MF136
- MF153
- MF148
- MF151
- MF720
- MF131
- MF130
- MF129
- MF143
- MF128
- MF135
- MF134
- MF140
- MF111
- MF100
- MF180
- MF112
- MF113
- MF101
- MF160
- MF141
- MF102
- MF103
- MF104



..... MF101



..... MF102



..... MF103



..... MF111



..... MF112



..... MF129



..... MF134



..... MF135



..... MF136



..... MF140



..... MF141



..... MF143



..... MF148



..... MF151



..... MF153

Estojo com escotilha * Estuche * Case

- 20 x 10 x 5 cm MF101LUV
- 26 x 12 x 6 cm MF102LUV
- 28 x 14 x 6 cm MF109



..... MF102LUV



.....



www.fava.com.br

Estojo Perfurado* Estuche Perforado * Case Perforated



..... MF101PFI



..... MF103PFI



..... MF104PFI



..... MF111PFI



..... MF112PFI



..... MF113PFI



..... MF134PFI



MF136PFI

6 x 3,5 x 3,5
 7 x 6 x 3 cm para 30 pontas/fresas/burs
 7 x 6 x 5 cm para 30 pontas/fresas/burs
 8 x 4 x 3 cm
 12 x 5 x 2 cm
 12 x 5 x 2 cm
 12 x 9 x 3 cm para grampos/grapa/champs
 18 x 4 x 3 cm
 18 x 7 x 2 cm
 18 x 8 x 2 cm
 18 x 8 x 3 cm
 18 x 8 x 5 cm
 19,5 x 19,5 cm para 15 instr.
 20 x 10 x 2 cm
 20 x 10 x 3 cm
 20 x 10 x 5 cm
 22,5 x 10,5 x 3 cm
 26 x 12 x 6 cm
 28 x 14 x 6 cm
 30 x 16 x 8 cm mod.maleta/valija/switcase.
 32 x 16 x 8 cm

MF136PFI ●
 MF148PFI ●
 MF703PFI ●
 MF150PFI ●
 MF143PFI ●
 MF122PFI ●
 MF133PFI ●
 MF135PFI ●
 MF134PFI ●
 MF140PFI ●
 MF111PFI ●
 MF100PFI ●
 MF149PFI ●
 MF112PFI ●
 MF113PFI ●
 MF101PFI ●
 MF141PFI ●
 MF102PFI ●
 MF103PFI ●
 MF145PFI ●
 MF104PFI ●



..... MF150PFI



..... MF125

Estojo Perio* Estuche * Case

- 19,5 x 19,5 cm perio estante móvel/mobile shelf para 15 instr.
- 20 x 10 x 2 cm perio com suporte/support para 8 instr. e sonda
- 20 x 10 x 3 cm perio estante móvel para 8 instr.
- 20 x 14 x 3 cm perio estante móvel/móvil shelf para 9 instr.
- 21 x 20 x 7 cm perio para/for 30 instr.

Plano Plain

MF 149
 MF126
 MF125
 MF 139
 MF 159

Perfurado Perforado Perforad

MF 149PFI
 MF126PFI
 MF125PFI
 MF 139PFI



..... MF139



..... MF149



..... MF126



- 7 x 6 x 5 cm endo para 24 limas / file
- 11 X 8,5 x 2 cm para cones de guta/cono/cones
- 12 x 5 x 2 cm endo com 8 divis.
- 12 x 9 x 3 cm para grampo/grapa/clamps
- 18 x 8 x 3 cm endo Uniararas -
- 18 x 8 x 5 cm endo 108 furos placa de alumínio / aluminum plate
- 18 x 8 x 5 cm endo 72 furos / placa de alumínio /w/ aluminum plate
- 20 x 10 x 2 cm endo com 18 divisórias e contra tampa inferior
- 20 x 10 x 5 cm endo 48 furos/agujeros/holes mod.Bauru
- 20 x 10 x 5 cm endo 48 furos/agujeros/holes mod. Dr.Leonardo
- 20 x 10 x 5 cm para endo 48 furos/agujeros/holes placa de alumínio
- 20 x 10 x 5 cm para endo 48 furos/agujeros/holes tubos de alumínio
- 20 x 10 x 5 cm para endo 72 furos/agujeros/holes placa de alumínio
- 21,5 x 15 x 7 cm medic. mod . Professor Machado
- 22,5 x 10,5 x 3 cm endo mod. Santos
- 22,5 x 10,5 x 3 cm endo mod. USP

Plano Plain

Perfurado Perforado Perforad

MF121	MF121PFI
MF132	-
MF122	MF122PFI
MF133	MF133PFI
	MF793PFI
MF123	MF123PFI
MF124	MF124PFI
MF117	-
MF119	MF119PFI
MF115	MF115PFI
MF118	-
MF116	MF116PFI
MF120	MF120PFI
MF160	-
MF138	MF138PFI
MF114	MF114PFI



MF114



MF115



MF119



MF120




MF121



MF122



MF124

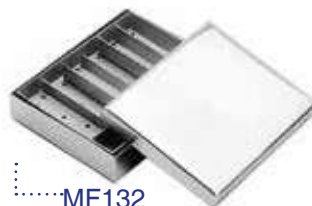

MF132



Bandeja * Tray

- 14 x 7 x 1 cm para agulhas de acun./ agujas de acupun./acupun.needles MF329
- 22 x 9 x 1,5 cm MF289
- 22 x 12 x 1,5 cm MF300
- 22 x 17 x 1,5 cm MF291
- 24 x 18 x 1,5 cm MF299
- 30 X 20 X 4 cm MF301
- 43 x 29 x 2 cm MF306
- 49 x 33 x 2 cm para equipo / vat / tray MF305



Cuba * Vat

- 20 x 10 x 2 cm suporte/soporte/support 07 instrum. MF287S
- 20 x 10 x 2 cm plana/plain MF287P
- 21,5 x 12 cm suporte/soporte/support 07 instrum. MF288
- 22 x 9 x 1,5 cm suporte/soporte/support 06 instrum. MF290
- 22 x 17 x 1,5 cm suporte/soporte/support 12 instrum. MF292



Cuba * Vat para gaze

- 7,5 x 7,5 x 3 cm gazes /gasas /gauzes MF327



Cuba * Vat para gaze

- 7,5 x 7,5 x 3 cm gazes /gasas /gauzes MF327



Estojo Redondo * Estuche * Case Round

- 3 x 1 cm brocas/fresas/burs MF146
- 7 x 1,5 cm para/for agulhas/agujas/needles MF110
- 8 x 3 cm 44 pontas/fresas/burs (22 fg/ 22ca) MF144
- 14 x 3 para gaze/gasa/gause tubular MF197



Régua de Proporção Áurea Regla de Proporción Áurea * Tray With Golden Ruler



MF8881

Porta algodão * Algodonero * Cotton Rack

- 8 x 10 cm limpo com mola/Algodonero limpio com muelle/Clean cotton rack with springs MF 212
- 8 x 10 cm Servido/Algodonero para sucio/Waste cotton Rack MF213
- 10 x 8 cm MF198
- 10 X 5,5 cm para rolos dentais/ para rollos dentales/ for dentals rolls MF196



Bandeja * Tray

- 21,5 x 12 x 2 cm – 7 instrum.
- 22 x 9 x 1,5 cm - 6 instrum.
- 22 x 9 x 1,5 cm lisa/plain
- 22 x 12 x 1,5 cm lisa/plain
- 22 x 12 x 1,5 cm perfurada/Perforado/Perforated
- 22 x 17 cm com suporte/suporte/support para 12 instrum.
- 22 x 17 x 1,5 cm lisa/plain
- 24 x 18 x 1,5 cm lisa/plain
- 30 X 20 X 4 cm lisa/plain
- 49 x 33 x 2 cm equipo/vat/tray

MF288042
MF290042
MF289042
MF300042
MF300042PFI
MF292042
MF291042
MF299042
MF301050
MF305050



.....MF300042



..... MF301050

Cuba Assepsia * Bowl

- 8 x 3,6 cm cap. 160ml MF320050
- 9 x 4,5 cm cap. 240 ml MF322050
- 10,5 x 4,5 cm cap. 340ml MF324050
- 13,5 x 4,5 cm cap. 530ml MF326050



Cuba Rim • Cuba Rinón • Oval Bowl

- 26 x 12 cm cap. 740 MF216050



Estojo Perfurado Autoclave * Estuche Perforado * Case Perforated



.....MF100PFIL2



.....MF113PFIL2

- 12 x 5 x 2 cm MF122PFIL2
- 18 x 7 x 2 cm MF134PFIL2
- 18 x 8 x 2 cm MF140PFIL2
- 18 x 8 x 3 cm MF111PFIL2
- 18 x 8 x 5 cm MF100PFIL2
- 20 x 10 x 3 cm MF113PFIL2
- 20 x 10 x 5 cm MF101PFIL2
- 26 x 12 x 6 cm MF102PFIL2

Estojo * Estuche * Case

- 12 x 5 x 2 cm MF143L2
- 12 x 5 x 2 cm endo 08 div. MF122L2
- 18 x 7 x 2 cm MF134L2
- 18 x 8 x 2 cm MF140L2
- 18 x 8 x 3 cm MF111L2
- 18 x 8 x 5 cm MF100L2
- 20 x 10 x 3 cm MF113L2
- 20 x 10 x 5 cm MF101L2
- 26 x 12 x 6 cm MF102L2



.....MF101L2



..... MF134L2



Estojo * Estuche * Case

- p/15 pontas/fresas/burs CA cor prata
- p/15 pontas/fresas/burs FG cor prata
- p/15 pontas/fresas/burs FG cor ferrugem/naranja/orange
- p/15 pontas/fresas/burs GATE cor prata
- p/15 pontas/fresas/burs pm cor prata
- p/21 pontas/fresas/burs FG cor prata
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. Ibirapuera perfurado/perforated
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. Prof. Machado
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. Prof. Machado perfurado/perforated
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. Cruzeiro do Sul Perfurado
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. Pucc perfurado/perforated
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. Ung/Unicid/Unisanta perfurado/perforated
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. Prof. Machado(novo)
- 12 X 8 X 7 cm endo mod. perfurado/perforated
- 20 x 10 x 2 cm
- 20 x 10 x 3 cm
- 20 x 10 x 3 cm perio – 8 instrum.
- 20 x 10 x 5 cm
- 10 pontas/fresas/burs FG e 05 CA cor prata
- 15 pontas/fresas/burs CA cor prata
- 15 pontas/fresas/burs FG cor prata
- 15 pontas/fresas/burs FG cor dourada/gold
- 15 pontas/fresas/burs FG cor ferrugem/naranja/Orange
- 15 pontas/fresas/burs gate cor prata
- 15 pontas/fresas/burs PM cor prata
- 18 pontas/fresas/burs cor prata
- 21 pontas/fresas/burs FG cor prata

MF168AL2
MF156AL2
MF158AL2
MF170AL2
MF177AL2
MF162AL2
MF16154PFI
MF161
MF161PFI
MF161172PFI
MF16160PFIUCC
MF16184PFI
MF16194
MF16160PFI
MF112A
MF113A
MF125A
MF101A
MF169A
MF168A
MF156A
MF157A
MF158A
MF170A
MF177A
MF152A
MF162A



..... MF161PFI



..... MF16154PFI



..... MF16160PFI



..... MF16172PFI



..... MF16194PFI



..... MF16184PFI

Tamborel * Drum - Alumínio * Aluminum

- Tamborel MF230A



www.fava.com.br

Régua Milim./ Regla/ Ruler



..... MF8880

Bacia * Bacia * Basin



- 32 cm Ø cap. 3100 ml MF270B
- 35 cm Ø cap. 4700 ml MF271B
- 41 cm Ø cap. 6300 ml MF272B

Bandeja * Tray

- 40 x 30 x 2 cm MF307



Comadre * Chata * BedpanBowlPerforated

- 40 x 30 cm tipo pá/pala/spade type cap.2.000ml MF218



Cuba Rim * Cuba Rinón * Oval BowlPerforated

- 26 x 12 cm cap. 740 ml MF216



Cuba Retangular com tampa * Cuba Rectangular * Rectangular

- 30 x 20 x 4 cm MF310
- 30 x 22 x 4 cm MF311
- 35 x 22 x 4 cm MF313



Papagaio * Orinal * Urinal

- 26 x 15 cm cap. 1.000 ml MF217



Cuba Retangular * Cuba Rectangular * Rectangular Vat/TrayBow

- 30 x 20 x 4 cm MF301
- 30 x 22 x 4 cm MF302
- 35 x 25 x 4 cm MF303
- 43 x 29 x 2 cm MF306
- 45 x 32 x 4,5 cm MF304
- 49 x 33 x 2 cm MF305



Irrigador * Irrigator

- 26 x 13 cm cap. 2.000 ml MF220



Cuba Redonda * Round * Bow

- 8 x 4 cm assepsia/asepsia/asepsis 160ml MF320
- 9 x 5 cm assepsia/asepsia/asepsis 240ml MF322
- 10,5 x 5 cm assepsia/asepsia/asepsis 340ml MF324
- 14 x 5 cm assepsia/asepsia/asepsis 530ml MF326



Balde sem tampa * Pail

- 23 x 18 cm cap. 5.000 ml MF214
- 29,5 x 31,5 cm cap. 15.000ml MF215



Escarradeira * Escupidera manual * ManualCuspidor

- 9 x 6,5 cm cap. 240 ml MF238



Tambor * DrumBowl

- 10 x 10 cm cap. 780 ml MF199
- 12 X 12 cm cap 1.350 ml MF200
- 16 X 14 cm cap 2.800 ml MF201
- 18 X 14 cm cap 3.560 ml MF202
- 19 X 19 cm cap 5.380 ml MF203
- 20 X 16 cm cap 5.000 ml MF204
- 24 X 16 cm cap 7.200 ml MF205
- 24 X 24 cm cap 10.850 ml MF206
- 29 X 16 cm cap 10.560 ml MF207
- 29 X 24 cm cap 15.840 ml MF208
- 29 X 29 cm cap 19.000 ml MF209
- 34 X 24 cm cap 21.700 ml MF210
- 39 X 27 cm cap 32.200 ml MF211



Estojo * Estuche * Case

- 18 x 8 x 5 cm. MF 100
- 20 x 10 x 25 cm. MF 101
- 26 x 12 x 6 cm. MF 102
- 28 x 14 x 6 cm. MF 103
- 30 x 16 x 8 cm mod. maleta/valija/suitcase MF 145
- 32 x 16 x 8 cm MF 104
- 36 x 22 x 9 cm MF 105
- 42 x 8 x 5 cm para sondas com alca/ alza / probes w / handle MF 106
- 42 x 16 x 6 cm parasondas com alca/ alza/probes w/handle MF 127
- 42 x 18 x 9 cm MF 107
- 42 x 28 x 12 cm MF 108

Plano Plain

- MF 100
- MF 101
- MF 102
- MF 103
- MF 145
- MF 104
- MF 105
- MF 106
- MF 127
- MF 107
- MF 108

Perfurado Perforado Perforad

- MF 100PFI
- MF 101PFI
- MF 102PFI
- MF 103PFI
- MF 145PFI
- MF 104PFI
- MF 105PFI
- MF 106PFI
- MF 127PFI
- MF 107PFI
- MF 108PFI



MF145



MF100



MF102PFI



MF103



MF105



MF103PFI



MF107



MF127



MF107PFI



Linha Termoplástica

- Estojo 18X10X02CM 185AZPEF - Azul
- Estojo 18X10X02CM 185BCPEF - Branco
- Estojo 18X10X02CM 185PKPEF - Pink
- Estojo 18X10X02CM 185VDPEF - Verde
- Estojo 18X10X02CM 185VMPEF - Vermelho



- Estojo 18X10X02CM P/ Perio P/ 08 Instrumentos 186AZPEF - Azul
- Estojo 18X10X02CM P/ Perio P/ 08 Instrumentos 186BCPEF - Branco
- Estojo 18X10X02CM P/ Perio P/ 08 Instrumentos 186PKPEF - Pink
- Estojo 18X10X02CM P/ Perio P/ 08 Instrumentos 186VCPEF - Verde
- Estojo 18X10X02CM P/ Perio P/ 08 Instrumentos 186VMPEF - Vermelho

Bandejas

TAM. 20X10X2 CM

TAM. 22,5X15X02 CM

- 286AZPEF - Azul
- 286BCPEF - Branco
- 286PKPEF - Pink
- 286VDPEF - Verde
- 286VMPEF - Vermelho

- 287AZPEF - Azul
- 287BCPEF - Branco
- 287PKPEF - Pink
- 287VDPEF - Verde
- 287VMPEF - Vermelho



BANDEJA 7 INSTRUMENTAIS

- 20X10X2 CM 2877AZPEF - Azul
- 20X10X2 CM 2877BCPEF - Branca
- 20X10X2 CM 2877PKPEF - Pink
- 20X10X2 CM 2877VCPEF - Verde
- 20X10X2 CM 2877VMPEF - Vermelho



CUBA REDONDA PEF

TAM. 09X5,5 CM

- 322AZPEF - Azul
- 322BCPEF - Branca
- 322APKPEF - Pink
- 322VDPEF - Verde
- 322VMPEF - Vermelha

- 324VDPEF - Azul
- 324BCPEF - Branca
- 324PKPEF - Pink
- 324VCPEF - Verde
- 324VMPEF - Vermelha

TAM. 10,5X05 CM



Cuba Rim * Cuba Rinón * Bowl Vat

- 26 x 12 cm branca/blanca/white MF430P



Broqueiro * Fresero * Burs

- 15 x 7,5 x 7 cm para/for 82 pontas/fresas/burs Com/whit 30 pontas/fresas/burs Fava(diversas)



- MF410P
- MF5030

Estojo * Estuche * Case

- 15 x 7,5 x 7 cm endo MF400P



Porta algodão * Algodonero * Cotton Rack

- Limpo e servido/ limpio y sucio/ clean and waste branca/blanca/white MF420P
- Limpo e servido/ limpio y sucio/ clean and waste marfim/marfil/ivory MF401P



* PEI = Autoclave

Máscara Cirúrgicas



Máscaras triplas descartáveis com elásticos, caixa com 50 un.

- Fabricado conforme norma ABNT 15052
- Cores disponíveis:
- 800101- Branca
- 800201- Verde
- 800301- Azul
- 800401- Rosa
- Anvisa 10317690011

Mascarillas triples Desechables con elásticos caja con 50 un.

- Fabricado según norma ABNT 15052
- Colores disponibles:
- 800101- Blanca
- 800201- Verde
- 800301- Azul
- 800401- Rosa

Disposable triple masks with elastic box with 50 units.

- Manufactured according to the ABNT 15052 (Brazilian Technical Standards Association)
- Colors Available:
- 800101- White
- 800201- Green
- 800301- Blue
- 800401- Pink

Máscaras Cirúrgicas descartáveis com tiras

Máscaras triplas descartáveis com tiras, caixa com 50 un.

- Fabricado conforme norma ABNT 15052
- Cores disponíveis:
- 800102- Branca
- 800202- Verde
- 800302- Azul
- Anvisa 10317690011

Mascarillas triples Desechables con cintas, caja con 50 un.

- Fabricado según norma ABNT 15052
- Colores disponibles:
- 800102- Blanca
- 800202- Verde
- 800302- Azul

Disposable triple masks with strips box with 50 units.

- Manufactured according to the ABNT 15052 (Brazilian Technical Standards Association)
- Colors Available:
- 800102- White
- 800202- Green
- 800302- Blue



Toucas descartáveis Brancas



- Toucas descartáveis brancas, caixa com 50 un. – Anvisa 10317690012
- Gorros desechables blancas, caja com 50un.
- White disposable headress box with 50 units.

Gorros descartáveis Brancos



900010

- Gorros Brancos masculino com elástico 50 gr., pacote com 10 un. – Anvisa 10317690012
- Gorros blancos masculino con elástico 50 gr. paquete con 10 un.
- White male headdress with elastic 50gr., Package with 10 units .

900011

- Gorros Brancos masculino com elástico 30 gr., pacote com 10 un. – Anvisa 10317690012
- Gorros blancos masculino con elástico 30 gr. paquete con 10 un.
- White male headdress with elastic 30gr., Package with 10 units .

Pro-pés

- Mf 613/1 – Pro-Pés descartáveis tamanho único TNT branco 30 gr. 100% Polipropileno, pacote com 50 pares.
- Cubre calçados- descartables tamaño único TNT blanco 30 gr. 100% de polypropylene, empaque con 50 pares
- Disposable shoe covers : one size, white TNT 30 gr. 100% Polypropylene, packing with 50 pairs.

Lençol Descartável

- MF 600/1 – Lençol descartável branco com elástico 10 unid.
- MF 600/1 – Sábana descartable Blanco con elástico 10 unid.
- MF 600/1 – Disposable Sheet whit elastic.



www.fava.com.br



Avental Descartável

- Avental Descartável – Branco pcte. c/ 10 unid. 20g
- Avental Descartables – Blanco bem c/10 unid.
- Disposable Apron – White packing with 10 unid
- MF 615/1 – Manga longa – Manga Larga –Long Sleeve
- MF 615/2 – Sem Manga – Sin Manga – No Sleeve
- MF 615/3 – Manga Curta – Manga Corta Short Sleeve




Pontas Diamantadas




● Esférica / Esferica / Round




● Cilíndrica Extremidade Plana / Cilindrica extremo plana / Cylinder flat end

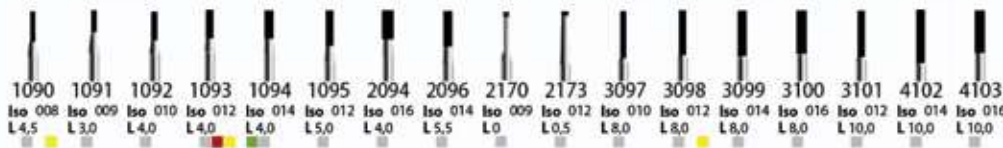

● Cilíndrica Extremidade Cônica Cilindrica extremo cônico / Cylinder conical end




● Cônica Extremidade Plana Cônica extremo plana / Conical flat end

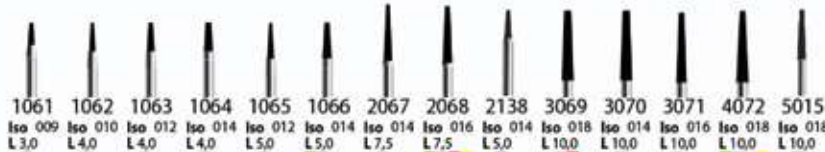


● Cônica Extremidade Ogival Cônica extremo ogival / Conical ogival end




● Chama Llama / Flame




● Tronco Cônica Invertida Cônica invertida / Inverted conical

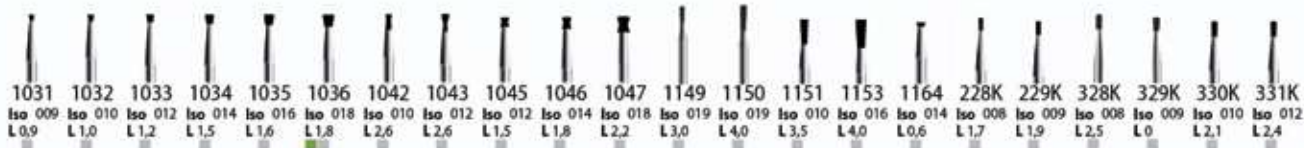

● Cônica Extremidade Chama Cônica extremo em ilama / Conical Flame end

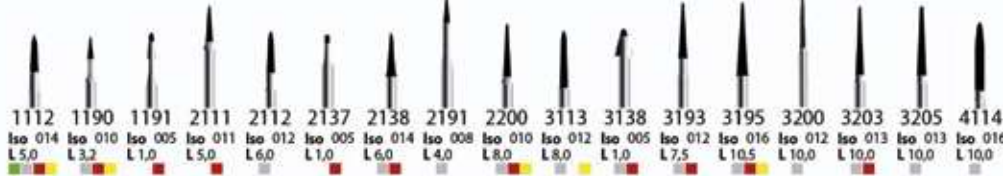

● Haste Curta Espiga corta / Short neck

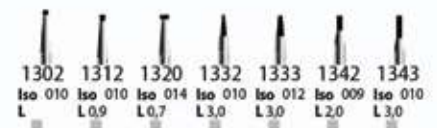


● Cônica Extremidade Arredondada Cônica extremo arredondado / Conical Flame



● Roda Rueda / Wheel




● Cônica Extremidade Ogival Cônica extremo ogival / Conical ogival end

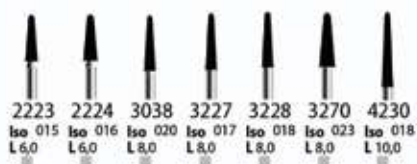


● Anelada Aniliada / Multiring



● Cônica Extremidade Arredondada Cônica extremo arredondado / Conical Flame




● Cônica Extremidade Inativa Cônica extremo liso / Conical safe end



Iso: Diâmetro máximo da parte ativa, expresso em décimo de milímetro L: Comprimento da parte ativa expresso em milímetro

Pontas Diamantadas / CA

Esférica / Esferica / Round

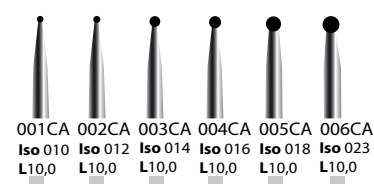


001CA Iso 010 L10,0
002CA Iso 012 L10,0
003CA Iso 014 L10,0
004CA Iso 016 L10,0
005CA Iso 018 L10,0
006CA Iso 023 L10,0

Roda
Rueda / Wheel




014CA Iso 018 L0,2
017CA Iso 025 L0,3

Tronco Cônica Invertida
Cônica invertida / Inverted conical

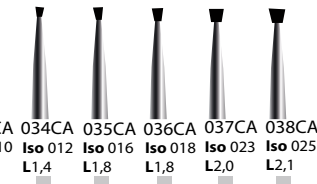


033CA Iso 010 L1,1
034CA Iso 012 L1,4
035CA Iso 016 L1,8
036CA Iso 018 L1,8
037CA Iso 023 L2,0
038CA Iso 025 L2,1

Cônica Extremidade Plana
Cônica extremo plana /
Conical flat end

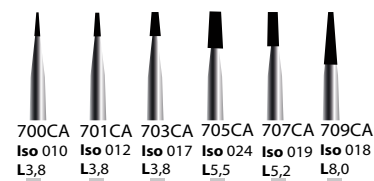


700CA Iso 010 L3,8
701CA Iso 012 L3,8
703CA Iso 017 L3,8
705CA Iso 024 L5,5
707CA Iso 019 L5,2
709CA Iso 018 L8,0

Cônica Extremidade Chama
Cônica extremo em ilama /
Conical Flame end



740CA Iso 014 L6,5
740CAHL Iso 014 L6,5


Cilíndrica Extremidade Plana
Cilindrica extremo plana /
Cylinder flat end



056CA Iso 009 L4,0
057CA Iso 014 L3,8
059CA Iso 018 L5,2
061CA Iso 024 L5,6


PM

Esférica / Esferica /
Round




001PM Iso 010 L
003PM Iso 016 L
006PM Iso 025 L
007PM Iso 029 L

Tronco Cônica Invertida
Cônica invertida / Inverted conical




033PM Iso 010 L1,3
035PM Iso 016 L1,5
038PM Iso 023 L2,1
042PM Iso 055 L2,9

Cilíndrica Extremidade Plana
Cilindrica extremo plana /
Cylinder flat end




056PM Iso 010 L4,0
057PM Iso 014 L4,5
061PM Iso 027 L5,1
082PM Iso 029 L10,0
085PM Iso 042 L10,0

NOVIDADE FAVA




PM 859 PM 83 PM 0,49 PM 0,46

Cônica Extremidade Plana
Cônica extremo plana /
Conical flat end




700PM Iso 018 L4,0
703PM Iso 018 L6,6
707PM Iso 018 L5,2
708PM Iso 018 L7,7

Cilíndrica Extremidade Arredondada
Cilindrica extremo redondeado /
Cylinder round end




710PM Iso 024 L10,0
715PM Iso 033 L10,0
716PM Iso 040 L10,0
717PM Iso 040 L10,0
718PM Iso 016 L8,3
720PM Iso 018 L10,0
721PM Iso 018 L10,0

Cônica Extremidade Arredondada
Cônica extremo redondeado /
Conical Flame



092PM Iso 035 L10,0
095PM Iso 042 L9,0

Roda
Rueda / Wheel



019PM Iso 050 L1,1
021PM Iso 021 L2,1

Cônica Topo Chama
Cônica Ilama
Conical Flame



740PM Iso 016 L8,0
744PM Iso 025 L9,0

Cônica
Conical



730PM Iso 055 L10,0

Broqueiros Aluminio * Fresero * Burs case



MF157A Cap. 15 Pontas
Fresas - Burs (FG)



MF162A Cap. 21 Pontas
Fresas - Burs (FG)



MF170A Cap. 15 Pontas
Fresas - Burs (CA)



MF177A Cap. 15 Pontas
Fresas - Burs (PM)



MF435L - 150 un.
Poliéster - polyester



MF436L - 2mm Aço - Acero - Steel
MF437L - 4mm Aço - Acero - Steel
MF438L - 6mm Aço - Acero - Steel

MF432L 2mm Diamantada - Diamond
Acabamentos - Acabamientos - Finishing
MF433L 2mm Diamantada - Diamond -
Polimento - Pulimento - Polishing

MF450L



0,05x7x500mm
Matriz aço - Matriz acero - Steel matrix

MF449L



MF5020 50 un.
100x10x0,05mm
Matriz poliéster
Polyester matrix



MF442DF
Disco diamantado
dupla face
Disco diamantado
doble cara
Double-face
diamond disk



MF455
18 Pontas
FresasBurs
Misto - Mezclado
Mixer



MF6006
7 Pontas Fresas
Burs
Kit acabamento fino
Kit acabamiento fino
Kit finishing fine



MF6007
7 Pontas Fresas
Burs
Kit acabamento fino e ultra fino
Kit acabamiento fino y fino fino
Kit finishing fine and ultra
fine



MF6008
7 Pontas Fresas
Burs
Kit acabamento ultra fino
Kit acabamiento ultra fino
Kit finishing ultra fine



MF6537
12 Pontas Fresas
Burs
Kit GRPD

+ 42 ANOS PRODUZINDO QUALIDADE

Fundada em 1976, a Metalúrgica Fava tem atuação destacada nos setores hospitalar e odontológico, resultado de muita dedicação aliada a competência e cuidado em cada etapa do processo produtivo. Iniciando com a fabricação de estojos, logo expandiu sua linha para bandejas, cubas e tambores, motivada pela necessidade de oferecer produtos de alta qualidade aos profissionais da área, isso fez com que a Metalúrgica Fava alcançasse uma posição de destaque e reconhecimento tanto no mercado nacional quanto internacional.

Apoiada em sua experiência e baseada nessa necessidade de estar qualificando o mercado com produtos compatíveis com a evolução do conhecimento adquirido por seus profissionais, em 1989 passamos a fabricar Pontas Diamantadas, com exclusivo processo de incorporação do diamante, conferindo maior durabilidade e resistência.

Em 2002, iniciamos a produção de máscaras e toucas descartáveis em polipropileno – no woven – resultado de investimentos realizados, com recursos próprios, na aquisição de máquinas de última geração, e qualificação pessoal.

Em 2010, com a mesma vocação e comprometimento com a qualidade, a empresa investiu na fabricação de instrumentos odontológicos e de podologia. Com máquinas de última geração e mão-de-obra qualificada, mais uma vez o sucesso foi alcançado, com o reconhecimento nas instituições e profissionais da área.

Sempre atenta as exigências de mercado e as Normas de Qualidade, a empresa investiu também na Identificação de sua produção. Com modernas máquinas de gravação a Laser, e a InkJet, nossos produtos são identificados com a Marca, Código e Lote, garantindo a sua Origem e Rastreabilidade.

No biênio 2014-2015, vendo a crescente demanda pelos seus produtos a Fava ampliou seu parque de máquinas com dois modernos Centros de Usinagem e Torneamento. Mais uma Máquina para Confecção de Máscaras com Elástico, além de outros investimentos em melhorias nos processos produtivos das linhas de Aço Inox, Instrumentais e Pontas Diamantadas, proporcionando aos seus clientes maior gama de produtos a pronta entrega.



Rua Luis Andrade, 146 - Pirituba - São Paulo - SP - Brasil
Cep 02920-000 / Tel. 55 11 3977-1000
www.fava.com.br / vendas@fava.com.br

[Encontre nossa loja](#)[Fale Conosco](#)[Meus Pedidos](#)[Rastreie seu pedido, aqui!](#)**Dental Med Sul**
Distribuindo Sorrisos

O que procura?

[Favoritos](#) [Entrar](#)[Carrinho](#)[Todas Categorias](#) ▼[Grandes Marcas](#) ▼[Rede de Clínicas](#)[Dentística](#)[Ortodontia](#)[Endodontia](#)[Anestesia](#)[Periféricos](#)[Harmonização Orofacial](#)[Prevenção E Profilaxia](#) > [Pedra Pomes](#) > [Pedra Pomes - AAF do Brasil](#)

Pedra Pomes - AAF do Brasil

Embalagem com 100g.

R\$ 5,24

Ou 12x R\$ 0,43 sem juros

R\$ 5,08 3% OFF no pagamento à vista no PIX[Negociar](#)**Fino**
(Cód.
26.7585)

-

1

[ADICIONAR
AO
CARRINHO](#)[CALCULAR O FRETE](#)[Clique aqui e confira as condições de Frete Grátis](#)

* Imagem ilustrativa

[Descrição](#) [Avaliações](#)

Para que é indicado a Pedra Pomes - AAF do Brasil?

A **Pedra Pomes** é indicado para limpeza e polimento do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica.

Características da Pedra Pomes - AAF do Brasil:

- Pó abrasivo fino.
- Alta qualidade e seguindo rigorosos padrões de produção.
- Evita danos ao esmalte dental.

A Trustvox certifica que a nota média da empresa Dental Med Sul é:

4.9 /5
NOTA DA EMPRESA



Baseado em 588 avaliações

A empresa Dental Med Sul se preocupa tanto com você consumidor que contratou uma empresa independente para auditar as avaliações. Legal, né? ;)

Avaliações reais, auditadas por  trustvox

Perguntas e respostas

Você tem alguma pergunta?

Escreva uma pergunta



Perguntar

Quem Comprou Comprou Também:

<					>
Pedra Pomes - Quimidrol	Pedra Pomes - AAF do Brasil	Pedra Pomes Extra Fina - Maquira	Pedra Pomes - 1k - Asfer	Pedra Pomes Pomitec Extra Fino -	
R\$ 4,89	R\$ 5,24	R\$ 10,97	R\$ 6,67	R\$ 16,07	
Ou 12 x de R\$ 0,40 sem juros	Ou 12 x de R\$ 0,43 sem juros	Ou 12 x de R\$ 0,91 sem juros	Ou 12 x de R\$ 0,55 sem juros	Ou 12 x de R\$ 1,33 sem juros	
ADICIONAR AO CARRINHO	ADICIONAR AO CARRINHO	ADICIONAR AO CARRINHO	ADICIONAR AO CARRINHO	ADICIONAR AO CARRINHO	



[Home](#) > [Dentística e Estética](#) > [Tira De Lixa](#) > Tiras Abrasivas de Poliéster - AAF

1/2



Tiras Abrasivas de Poliéster - AAF

Embalagem com 150 unidades.

Cod. de Referência: 658934

★★★★★ (1)

R\$13,90

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos✓

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

 **Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.

 **Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.

 **Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento ▾

Detalhes ^

* Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170mm de

comprimento.
Possui centro neutro (sem
abrasivo).

Aplicação 

Tire dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas. Faça a primeira!

Fazer uma pergunta

Avaliações deste produto



5 estrelas	(1)
4 estrelas	(0)
3 estrelas	(0)
2 estrelas	(0)
1 estrela	(0)

100% recomendam este produto

Ordenar

Avaliar produto



Muito bom!

Pensando em custo benefício. a melhor

Dra. C. 20/05/2023

 *Compra verificada*

 *Sim, recomendaria este produto a um amigo.*

 Útil? (1)

Carregar mais avaliações

Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG nº 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.



O que procura?

Favoritos Entrar

Carrinho

Todas Categorias ▾ Grandes Marcas ▾ Rede de Clínicas

Dentística

Ortodontia

Endodontia

Anestesia

Periféricos

Harmonização Orofacial

[🏠](#) > Dentística E Estética > Barreira Gengival > Barreira Gengival - AAF do Brasil

Barreira Gengival - AAF do Brasil

Embalagem com 1 seringa 2g.
Azul.

R\$ 13,00

Ou 12x R\$ 1,08 sem juros

R\$ 12,61

3% OFF no pagamento à vista no
PIX

Negociar

27.1588

- 1

+ DISPONÍVEL



* Imagem ilustrativa

Descrição Avaliações

Para que é indicado a Barreira Gengival - AAF do Brasil?

Indicada como substituto do lençol de borracha para a proteção do tecido gengival e nos casos de risco de irritação por contato com produtos utilizados no procedimento clínico, como, por exemplo, clareamento dental e como coadjuvante no isolamento absoluto para

melhor vedação de um preparo cavitário ou tratamento endodôntico. Proteger da incidência de luz solar direta e armazenar em temperaturas de 5 a 28°C.

Características da Barreira Gengival - AAF do Brasil:

- Fotopolimerizável
- Não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente.
- Possui viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis.
- Excelente poder de vedação.
- Aderência mínima e perfeita sobre a gengiva.
- Não solta da gengiva a menos que forçada.
- Sai por inteiro no momento de retirá-la.
- Rendimento até 5 aplicações de arcada completa.

Confira o manual de instrução:

https://afdobrasil.ind.br/bulas/barreira-gengival-fotopolimerizavel_br.pdf



Aproximadamente 5.450 resultados (0,35 segundos)

Patrocinado



Barreira Gengival -...
R\$ 13,00
Dental Med ...



Barreira Gengival...
R\$ 12,90
Dental Speed



Barreira Gengival...
R\$ 12,90
Dental Vidafer...



Barreira Gengival...
R\$ 14,50
Dentvi



Barreira Gengival...
R\$ 24,90
Dental Cremer

Patrocinado



Dental Med Sul
<https://www.dentalmedsul.com.br>

Barreira Gengival - Aaf Do Brasil - Barreira Gengival

Adquira seu produto na Dental Med Sul, a mais completa loja de Produtos Odontológicos. Com os melhores preços, facilidade de pagamento, e grandes descontos. Melhores Marcas.

[Produtos de Endodontia](#) · [Produtos de Ortodontia](#)

Patrocinado



Dental Cremer
<https://www.dentalcremer.com.br>

Barreira Gengival Fotopolimerizável - Aaf

✓ Identidade da empresa verificada — Só a maior Dental da América Latina te traz as melhores ofertas. Confira! Tudo em...

Classificação de dentalcremer.com.br: 4,8 - 2.461 comentários



Dental Med Sul
<https://www.dentalmedsul.com.br> > ... > Barreira Gengival

Barreira Gengival - AAF do Brasil

Características da Barreira Gengival - AAF do Brasil: · Fotopolimerizável · Não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. · Possui viscosidade e ...

R\$ 13,00

As pessoas também perguntam

Para que serve a barreira gengival?

O que é top Dam?

Como usar top Dam?

O que é uma barreira dental?

Feedback



Surya Dental
<https://www.suryadental.com.br> > barreira-gengival-com...

Barreira Gengival com 2 gramas - AAF do Brasil

A Barreira Gengival AF do Brasil é uma resina fotopolimerizável que não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente.

Barreira Gengival AAF do Brasil

(1)

Detalhes

Comentários

Loja





Drogaria São Paulo
Barreira Gengival - AA...
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 2,50 até 22 de mar. · Grátis a partir de R\$ 140,01
Até 7 dia(s)



Dental Speed
Barreira Gengival...
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 30 entre 25 - 27 de mar. · Grátis a partir de R\$ 199,01
Até 7 dia(s)



Dental Med Sul
Barreira Gengival - ...
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 20 entre 20 - 24 de mar. · Grátis a partir de R\$ 99,01
Até 7 dia(s)



Drogarias Pacheco
Barreira Gengival - AA...
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 2,50 até 22 de mar. · Grátis a partir de R\$ 140,01
Até 7 dia(s)



drclareamento.com.br
Barreira Gengival...
Em estoque on-line
Até 7 dia(s)

→ Comparar preços

Fee

A Barreira Gengival AF do BRASIL é uma resina Fotopolimerizável, não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. Possui viscosidade e tixot. [MAIS](#) ▾

→ Mais detalhes

Avaliações do usuário



Dental Vidaфарма

https://www.dentalvidafarma.com.br › barreira-gengival-...

Barreira Gengival Fotopolimerizável - AAF do Brasil

* A **Barreira Gengival** é uma resina Fotopolimerizável, não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. * Possui viscosidade e tixotropia adequados para ...
R\$ 12,90



Dental Speed

https://www.dentalspeed.com › barreira-gengival-fotop...

Barreira Gengival Fotopolimerizável - AAF

Barreira Gengival Fotopolimerizável - **AAF**. Embalagem com 1 seringa de 2g e 2 pontas aplicadoras. Cod. de Referência: AAF25008A.
Avaliação: 5 · 100 comentários
Não inclui: **brasil** | Precisa incluir: **brasil**



souodonto.com

https://souodonto.com › barreira-gengival-fotopolimeriz...

Barreira Gengival Fotopolimerizavel - AAF DO BRASIL

Indicação: Indicada como substituto do lençol de borracha para a proteção do tecido **gengival** e nos casos de risco de irritação por contato com produtos ...



Pacheco

https://www.drogariaspacheco.com.br › Outros

Barreira Gengival - AAF do Brasil - 27.1588

Características da **Barreira Gengival - AAF do Brasil**: · Fotopolimerizável · Não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. · Possui viscosidade e tixotropia ...
R\$ 10,65



Dental Botelho

https://dentalbotelho.com.br › produto › barreira-gengi...

Barreira Gengival Fotopolimerizável Azul – AAF do Brasil

* A **Barreira Gengival** é uma resina Fotopolimerizável, não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. * Possui viscosidade e tixotropia adequados para ...
R\$ 13,00 · **Em estoque**



Dental Odonthomaz

https://www.dentalodonthomaz.com.br › dentistica › ba...

Barreira Gengival Fotopolimerizável - Aaf do Brasil

Barreira Gengival Fotopolimerizável - **Aaf do Brasil** na Dental Odonthomaz [R\$ 10,44 à vista ou em x de R\$ sem juros]
R\$ 10,44



Dental Ecoglobal

https://dentalecoglobal.com.br › barreira-gengival-fotop...

Barreira Gengival Fotopolimerizavel

Embalgem com 1 seringa 2g. **AAF DO BRASIL**. Código do produto: 1815. R\$ 12,90.
Quantidade:..
R\$ 12,90



AF do Brasil Produtos Odontológicos

https://afdobrasil.ind.br › produtos › linha-quimica

AF do Brasil Produtos Odontológicos

A **Barreira Gengival** AF do **BRASIL** é uma resina Fotopolimerizável, não traz irritação aos tecidos gengivais do paciente. Possui viscosidade e tixotropia adequados ...

Mais resultados

5,0

1 comentário

D

Dra. A.

5

9 meses atrás

Traduzir

Usabilidade e Resultado surpreendente ... Com e valor atrativo, virou minha queridinha

Avaliado em dentalspeed.com

→

Mais avaliações

Fee



dental botelho
odonto hospitalar



(<http://www.dentalbotelho.com.br/account/>)

(<http://www.dentalbotelho.com.br/account/>)

(<https://dentalbotelho.com.br>)

O que você procura ?



Matriz de Aço Seccional Pré-contornada Anatômica C/ 50 Unds – Preven

R\$ 89,00

Embalagem com 50 unidades.

MATRIZ PREVEN

Escolha um

1

Comprar

SKU: Não aplicável Categoria:

[Matrizes](#)

(<https://dentalbotelho.com.br/product-category/matrizes/>)

Dental Botelho Chapadinha

(<https://dentalbotelho.com.br/store/dental-botelho-chapadinha/>)

☆☆☆☆☆

[Report Abuse](#)

Descrição	Shipping	Informação adicional
Avaliações (0)	Vendor Info	More Products
Product Enquiry		

Descrição

- * Produzidas em titânio, ultrafinas (0,03mm) e com excelente memória elástica.
- * Fácil de manusear, oferecem um perfeito equilíbrio entre flexibilidade e rigidez para otimizar o posicionamento e a adaptação em espaços inter-proximais estreitos.
- * Sua espessura reduzida e liga de metal aprimorada, resistem a deformação, pois apresentam alta resiliência elástica que permite que voltem a sua forma original.

Informação adicional

MATRIZ PREVEN	Grande, Média, Sortida
---------------	------------------------

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Matriz de Aço Seccional Pré-contornada Anatômica C/ 50 Unds – Preven”

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Sua avaliação *

Sua avaliação sobre o produto *

Nome *

E-mail *

☐

Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Enviar

Vendor Information

- Store Name: Dental Botelho Chapadinha
- Vendor: [Dental Botelho Chapadinha](https://dentalbotelho.com.br/store/dental-botelho-chapadinha/)
(<https://dentalbotelho.com.br/store/dental-botelho-chapadinha/>)
- **Address:** Travessa Manoel Leite, 37, Centro
Chapadinha
Maranhão
65.500-000
- No ratings found yet!



Arco de Aço SS Stainless Redondo (PAGUE 10 LEVE12) – Orthometric R\$ 6,50 (https://dentalbotelho.com.br/produto/arco-de-aco-ss-stainless-redondo-pague-10-leve12-orthometric/)	Estojo para Esterilização Inox Perfurado Autoclavável 26x12x6cm – Golgran R\$ 167,90 (https://dentalbotelho.com.br/produto/estojo-para-esterilizacao-inox-perfurado-autoclavavel-26x12x6cm-golgran/)	Fio Dental Floss Picks (Fita Dental) C/10 und – Powerdent R\$ 6,00 (https://dentalbotelho.com.br/produto/fio-dental-floss-picks-fita-dental-c-10-und-powerdent/) Comprar	Membrana Biológica Reabsorvível Surgtime Collagen (20x30cm) – Bionnovation R\$ 469,00 (https://dentalbotelho.com.br/produto/membrana-biologica-reabsorvivel-surgtime-collagen-20x30cm-bionnovation/) Comprar
---	---	---	---

Fixador de Raio-X 475ml – Lysanda R\$ 24,90 (https://dentalbotelho.com.br/produto/fixador-de-raio-x-475ml-lysanda/)	Porta Algodão Servido de Alumínio C/ 1 Und – Preven R\$ 50,00 (https://dentalbotelho.com.br/produto/porta-algodao-servido-de-aluminio-c-1-und-preven/) Comprar
--	---

Product Enquiry

Your Name

you@example.com

Details about your enquiry...

Submit Enquiry

Produtos relacionados

Fita Banda Matriz Metálica – Maquira	Tira de Lixa de Poliéster (4mmX170mm) C/150 Unds – AAF do Brasil	Fita Banda Matriz de Poliéster Airon C/50 unds – Maquira	Fita Banda Matriz Metálica 5mm (0,05mm) – Fava
R\$ 3,90	R\$ 13,90	R\$ 4,00	R\$ 5,04
(https://dentalbotelho.com.br/produto/fita-banda-matriz-metalica-maquira/)	(https://dentalbotelho.com.br/produto/tira-de-lixade-poliester-4mmx170mm-c-150-unds-aaf-do-brasil/)	(https://dentalbotelho.com.br/produto/fita-banda-matriz-de-poliester-airon-c-50-unds-maquira/)	(https://dentalbotelho.com.br/produto/fita-banda-matriz-metalica-5mm-005mm-fava/)
Ver opções	Comprar	Comprar	Comprar

INSTITUCIONAL

Sobre Nós(https://dentalbotelho.com.br/quem-somos/)
Navegue por filial (breve)
Fale (https://api.whatsapp.com/send/?phone=5598996013385&text=Estou+visitando+sua+loja+virtual+tenho+uma+d%C3%BAvida.+Poderia+me+ajudar%3F&type=

AJUDA

Política de Privacidade(https://dentalbotelho.com.br/politica-de-privacidade/)
Política de Devolução e Troca(https://dentalbotelho.com.br/politica-de-troca-e-reembolso/)
Rastreamento de Pedidos(https://dentalbotelho.com.br/my-account/)
✉ sac@dentalbotelho.com.br(mailto:sac@dentalbotelho.com.br)
(98)
9 (https://api.whatsapp.com/send/?phone=5598996013385&text=Estou+visitando+sua+loja+virtual+tenho+uma+d%C3%BAvida.+Poderia+me+ajudar%3F&type=3385

FORMAS DE PAGAMENTO

(https://www.instagram.com/dentalbotelho)
Nossas redes

Copyright © 2024

Todos os direitos reservados | www.dentalbotelho.com.br | R Botelho Rego | CNPJ: 19.837.359/0001-46 | Travessa Manoel Leite, 37 Centro Chapadinha
Maranhão - CEP 65500-000 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Produtos para Saúde (Correlatos): 8.26696-4, Medicamentos: 1.28388-6,
Medicamento Especial (AE) 1.28619-4, Saneantes: 3.11806-4, Cosmético: 4.05184-1 - Responsável Técnica Farmacêutica Layres Lima Ferreira CRF 3777 - Fotos
meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do

Carrinho de Compra.



[Início](#) > Resultados da busca por:

Buscando por: mandril preven

Itens 1 - 1 de 1

Ordenar por

Relevância



Mandril Para Discos CA - Preven

Embalagem com 1 unidade.

R\$3,49

-

1

+

Adicionar

Produtos por página

24

1

Copyright © 2023 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2º andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG nº 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.



Aproximadamente 202.000 resultados (0,27 segundos)



Preven

https://www.preven.com.br › Produtos › Tiras

Banda Matriz

A Banda Matrizé indicada para restaurações em dentes posteriores, não permitindo extravasar o material restaurador que se coloca no dente.



Dental Cremer

https://www.dentalcremer.com.br › fita-banda-matriz-m...

Fita Banda Matriz Metálica - Preven - Dental Cremer

Fita Banda **Matriz Metálica** em bobina **Preven** em aço inoxidável maleável nas larguras de 5mm e 7mm. Compre agora pelo melhor preço na Dental Cremer!
Avaliação: 5 · 100 comentários · **R\$ 1,79** · **Em estoque**



Dental & Cia

https://www.dentalecia.com.br › Matriz

Fita Banda Matriz Metálica 0,05x5x500mm - Preven

- Disponível na largura de 5mm.- Espessura de 0,05mm. Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitario e tambem usada como **matriz**. - ...
R\$ 1,90 · **Em estoque**



Dental Speed

https://www.dentalspeed.com › banda-matriz-metalica-5...

Fita Banda Matriz Metálica - Preven

Protege os dentes adjacentes durante o preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo; Apresentada em bobina, poder ser cortada no tamanho desejado; ...
Avaliação: 5 · 100 comentários · **R\$ 1,79** · **Em estoque**



Dental Orto Dente

https://www.dentalortodente.com.br › fita-banda-matriz...

PREVEN-FITA Banda Matriz 0,05X7MM - ortodente

FITA-BANDA-MATRIZ-METALICA-005X7MM---PREVEN. FITA Banda Matriz Metálica 0,05X7MM - **PREVEN**. ref: 9852. Opinião dos Consumidores:0. Por: R\$ 1,79ou 1x de R\$ 1,79.
R\$ 1,79 · **Em estoque**



dentalmaiss.com.br

https://www.dentalmaiss.com.br › dentistica-e-estetica › f...

Fita Banda Matriz Metálica 7MM - Preven - Dental Mais

* Protege os dentes adjacentes durante o preparo, condicionamento ácido e aplicação do adesivo. * Apresentada em bobina, poder ser cortada no tamanho desejado.
R\$ 2,07 · **Em estoque**



Dental Orto Dente

https://www.dentalortodente.com.br › fita-banda-matriz...

PREVEN-FITA Banda Matriz 0,05X5MM - ortodente

... MATRIZ-METALICA-005X5MM---PREVEN. FITA Banda Matriz Metálica 0,05X5MM - **PREVEN**. ref: 9851. Opinião dos Consumidores:0. Por: R\$ 1,59ou 1x de R\$ 1,59. Preço a ...
R\$ 1,59 · **Em estoque**



Dental & Cia

https://www.dentalecia.com.br › Matriz

Fita Banda Matriz Metálica 0,05x7x500mm - Preven

Utilizada para proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário e também usada como **matriz**. * Protege os dentes adjacentes durante o preparo.
R\$ 1,90

Patrocinado

 Fita Banda Matriz... R\$ 1,79 Dental Cre...	 Fita Banda Matriz... R\$ 1,90 Dental & Cia Gratis 26/03	 Fita Band Matriz... R\$ 1,79 Dental Sp
 Fita Matriz De Aco 0,05m... R\$ 1,94 Surya Dental	 Banda Matriz 7mm -... R\$ 2,24 So Medica	 PROMOÇÃO BANDA MATRIZ 7mm R\$ 3,30 Dental Cr

Mais no Google



Preven

<https://www.preven.com.br> › banda-matriz-aco-inox-5...

Banda matriz de aço inox 5mm

Quando a busca é por banda **matriz** de aço inox 5mm aqui com os profissionais especializados da **Preven** você encontrará precisão com serviços com alta qualidade.



Dental Odonthomaz

<https://www.dentalodonthomaz.com.br> › ... › Matriz

Fita Banda Matriz Metálica 5mm - Preven

A fita banda **matriz metálica** 5mm da **marca Preven** é um produto utilizado na área de odontologia. Essa fita é especialmente projetada para auxiliar no ...

R\$ 1,45 · **Em estoque**

Pesquisas relacionadas

matriz **metálica odontologia**matriz **de cobre odontologia****porta** matrizmatriz **para restauração****tira** matriz **kdent**matriz **parcial biconvexa**

Mais resultados

Ofertas selecionadas especialmente para você. Confira!



[Início](#) > Resultados da busca por:

Você quis dizer: fio retrator aaf

Itens 1 - 1 de 1



Ordenar por

Relevância



Fio Retrator Retraf - AAF

Embalagem com 1 unidade de 250cm. Escolha o tamanho.

R\$24,90

Confira itens*

Ver Opções

Produtos por página

24

1

Copyright © 2023 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2º andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG nº 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.



DESCRIÇÃO

Master Temp é um compósito resinoso autopolimerizável indicado para confecção de provisórios estéticos de longa duração para procedimentos indiretos como inlays, onlays, coroas, facetas e pontes. Indicado também para o reembasamento de restaurações pré-fabricadas de resina, policarbonato ou metal, e também em procedimentos de mock-up (simulações de próteses, como os laminados).

3. Selecionar a cor da resina pretendida e inserir o respectivo cartucho no dispensador/pistola ou utilizar a respectiva seringa (consulte “Utilização do cartucho de Automistura” / consulte “Utilização da seringa de corpo duplo”). **Nota:** Para evitar a formação de bolhas é importante que a ponteira misturadora permaneça sempre imersa no material durante a aplicação. Durante o enchimento manter o excesso de material a um mínimo possível.

4. Encher a impressão (moldagem) ou a moldeira com Master Temp. Aplicar primeiro o material nas áreas occlusais da impressão ou da moldeira e encher em direção às áreas gengivais.

5. Colocar a impressão ou a moldeira enchida com a resina Master Temp sobre o dente preparado, no máximo 45 segundos após o início da mistura, aplicando uma pressão moderada, e fixar.

6. O processo de presa tem de ser monitorizado intraoralmente (por exemplo com uma sonda), dado a polimerização ser afetada significativamente pela temperatura da boca e a remoção do provisório apenas ser possível durante a fase elástica.

7. Remover a camada de inibição de oxigénio da superfície do provisório antes da preparação (por exemplo com álcool).

8. Aproximadamente 5 minutos após o início da mistura preparar o provisório com uma fresa de dentes cruzados, discos flexíveis, etc.

9. Verificar a oclusão e, se necessário, retificar com instrumentos adequados.

10. Se necessário, aplicar na superfície do provisório um verniz de alto brilho fotopolimerizável ou poli manualmente com um polidor de borracha ou escova de cerdas de pelo de

DESCRIÇÃO

Master Temp é um compósito resinoso autopolimerizável indicado para confecção de provisórios estéticos de longa duração para procedimentos indiretos como inlays, onlays, coroas, facetas e pontes. Indicado também para o reembasamento de restaurações pré-fabricadas de resina, policarbonato ou metal, e também em procedimentos de mock-up (simulações de próteses, como os laminados).

3. Selecionar a cor da resina pretendida e inserir o respectivo cartucho no dispensador/pistola ou utilizar a respectiva seringa (consulte “Utilização do cartucho de Automistura” / consulte “Utilização da seringa de corpo duplo”). **Nota:** Para evitar a formação de bolhas é importante que a ponteira misturadora permaneça sempre imersa no material durante a aplicação. Durante o enchimento manter o excesso de material a um mínimo possível.

4. Encher a impressão (moldagem) ou a moldeira com Master Temp. Aplicar primeiro o material nas áreas occlusais da impressão ou da moldeira e encher em direção às áreas gengivais.

5. Colocar a impressão ou a moldeira enchida com a resina Master Temp sobre o dente preparado, no máximo 45 segundos após o início da mistura, aplicando uma pressão moderada, e fixar.

6. O processo de presa tem de ser monitorizado intraoralmente (por exemplo com uma sonda), dado a polimerização ser afetada significativamente pela temperatura da boca e a remoção do provisório apenas ser possível durante a fase elástica.

7. Remover a camada de inibição de oxigénio da superfície do provisório antes da preparação (por exemplo com álcool).

8. Aproximadamente 5 minutos após o início da mistura preparar o provisório com uma fresa de dentes cruzados, discos flexíveis, etc.

9. Verificar a oclusão e, se necessário, retificar com instrumentos adequados.

10. Se necessário, aplicar na superfície do provisório um verniz de alto brilho fotopolimerizável ou poli manualmente com um polidor de borracha ou escova de cerdas de pelo de

DESCRIÇÃO

Master Temp é um compósito resinoso autopolimerizável indicado para confecção de provisórios estéticos de longa duração para procedimentos indiretos como inlays, onlays, coroas, facetas e pontes. Indicado também para o rebase de restauraciones prefabricadas de resina, policarbonato o metal, y también en procedimientos de mock-up (simulaciones de prótesis, como los laminados).

3. Selecionar el color de la resina pretendida e insertar el respectivo cartucho en el dispensador/pistola o utilizar la respectiva jeringa (consulte “Utilización del cartucho de Automezcla” / consulte “Utilización de la jeringa de cuerpo doble”).

4. Llenar la impresión (moldeo) o la férula con Master Temp. Aplicar primero el material en las áreas oclusales de la impresión o de la férula y llenar en dirección a las áreas gingivales.

5. Colocar la impresión o la férula rellena con la resina Master Temp sobre el diente preparado, al máximo 45 segundos después del inicio de la mezcla, aplicando una presión moderada, y fijarla.

6. El proceso de presa tiene que ser monitorizado intraoralmente (por ejemplo con una sonda), dado a que la polimerización sea afectada significativamente por la temperatura de la boca y la retirada del provisorio solamente es posible durante la fase elástica.

7. Quitar la camada de inhibición de oxígeno de la superficie del provisorio antes de la preparación (por ejemplo, con alcohol).

8. Aproximadamente 5 minutos después del inicio de la mezcla preparar el provisorio con una fresa de dientes cruzados, discos flexibles, etc.

9. Verificar la oclusión y, si necesario, rectificar con instrumentos adecuados.

10. Si necesario, aplicar en la superficie del provisorio un barniz de alto brillo fotopolimerizable o pulir manualmente con un pulidor de caucho o cepillo de cerdas de pelo de cabra.

11. Limpiar el coto, secar y quitar el lubricante.

12. Fijación del provisorio.

13. Verificar la oclusión y adaptar de forma correspondiente.

14. En la primera utilización de un cartucho expulsar una cantidad de material del tamaño de una arveja y desecharla.

15. Mezclar el material presionando la palanca en el dispensador/pistola en la puntera mezcladora y aplicar directamente.

16. Mantener la puntera mezcladora utilizada después de la aplicación en el cartucho para servir de tapa.

17. Retirada del cartucho:

1. Presionar la palanca en la parte posterior del dispensador/pistola para arriba y tirar la corrediza completamente para atrás.

2. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

3. Retirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

4. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

5. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

6. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

7. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

8. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

9. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

10. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

11. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

12. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

DESCRIPCIÓN

Master Temp es un composite resinoso autopolimerizable indicado para confección de provisórios estéticos de longa duração para procedimentos indiretos como inlays, onlays, coroas, carillas y puentes. Indicado también para el rebase de restauraciones prefabricadas de resina, policarbonato o metal, y también en procedimientos de mock-up (simulaciones de prótesis, como los laminados).

3. Seleccionar el color de la resina pretendida e insertar el respectivo cartucho en el dispensador/pistola o utilizar la respectiva jeringa (consulte “Utilización del cartucho de Automezcla” / consulte “Utilización de la jeringa de cuerpo doble”).

4. Llenar la impresión (moldeo) o la férula con Master Temp. Aplicar primero el material en las áreas oclusales de la impresión o de la férula y llenar en dirección a las áreas gingivales.

5. Colocar la impresión o la férula rellena con la resina Master Temp sobre el diente preparado, al máximo 45 segundos después del inicio de la mezcla, aplicando una presión moderada, y fijarla.

6. El proceso de presa tiene que ser monitorizado intraoralmente (por ejemplo con una sonda), dado a que la polimerización sea afectada significativamente por la temperatura de la boca y la retirada del provisorio solamente es posible durante la fase elástica.

7. Quitar la camada de inhibición de oxígeno de la superficie del provisorio antes de la preparación (por ejemplo, con alcohol).

8. Aproximadamente 5 minutos después del inicio de la mezcla preparar el provisorio con una fresa de dientes cruzados, discos flexibles, etc.

9. Verificar la oclusión y, si necesario, rectificar con instrumentos adecuados.

10. Si necesario, aplicar en la superficie del provisorio un barniz de alto brillo fotopolimerizable o pulir manualmente con un pulidor de caucho o cepillo de cerdas de pelo de cabra.

11. Limpiar el coto, secar y quitar el lubricante.

12. Fijación del provisorio.

13. Verificar la oclusión y adaptar de forma correspondiente.

14. En la primera utilización de un cartucho expulsar una cantidad de material del tamaño de una arveja y desecharla.

15. Mezclar el material presionando la palanca en el dispensador/pistola en la puntera mezcladora y aplicar directamente.

16. Mantener la puntera mezcladora utilizada después de la aplicación en el cartucho para servir de tapa.

17. Retirada del cartucho:

1. Presionar la palanca en la parte posterior del dispensador/pistola para arriba y tirar la corrediza completamente para atrás.

2. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

3. Retirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

4. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

5. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

6. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

7. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

8. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

9. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

10. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

11. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

12. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

DESCRIPCIÓN

Master Temp es un composite resinoso autopolimerizable o pulir manualmente con un pulidor de caucho o cepillo de cerdas de pelo de cabra.

3. Seleccionar el color de la resina pretendida e insertar el respectivo cartucho en el dispensador/pistola o utilizar la respectiva jeringa (consulte “Utilización del cartucho de Automezcla” / consulte “Utilización de la jeringa de cuerpo doble”).

4. Llenar la impresión (moldeo) o la férula con Master Temp. Aplicar primero el material en las áreas oclusales de la impresión o de la férula y llenar en dirección a las áreas gingivales.

5. Colocar la impresión o la férula rellena con la resina Master Temp sobre el diente preparado, al máximo 45 segundos después del inicio de la mezcla, aplicando una presión moderada, y fijarla.

6. El proceso de presa tiene que ser monitorizado intraoralmente (por ejemplo con una sonda), dado a que la polimerización sea afectada significativamente por la temperatura de la boca y la retirada del provisorio solamente es posible durante la fase elástica.

7. Quitar la camada de inhibición de oxígeno de la superficie del provisorio antes de la preparación (por ejemplo, con alcohol).

8. Aproximadamente 5 minutos después del inicio de la mezcla preparar el provisorio con una fresa de dientes cruzados, discos flexibles, etc.

9. Verificar la oclusión y, si necesario, rectificar con instrumentos adecuados.

10. Si necesario, aplicar en la superficie del provisorio un barniz de alto brillo fotopolimerizable o pulir manualmente con un pulidor de caucho o cepillo de cerdas de pelo de cabra.

11. Limpiar el coto, secar y quitar el lubricante.

12. Fijación del provisorio.

13. Verificar la oclusión y adaptar de forma correspondiente.

14. En la primera utilización de un cartucho expulsar una cantidad de material del tamaño de una arveja y desecharla.

15. Mezclar el material presionando la palanca en el dispensador/pistola en la puntera mezcladora y aplicar directamente.

16. Mantener la puntera mezcladora utilizada después de la aplicación en el cartucho para servir de tapa.

17. Retirada del cartucho:

1. Presionar la palanca en la parte posterior del dispensador/pistola para arriba y tirar la corrediza completamente para atrás.

2. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

3. Retirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

4. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

5. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

6. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

7. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

8. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

9. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

10. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

11. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

12. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

DESCRIPCIÓN

Master Temp es un composite resinoso autopolimerizable o pulir manualmente con un pulidor de caucho o cepillo de cerdas de pelo de cabra.

3. Seleccionar el color de la resina pretendida e insertar el respectivo cartucho en el dispensador/pistola o utilizar la respectiva jeringa (consulte “Utilización del cartucho de Automezcla” / consulte “Utilización de la jeringa de cuerpo doble”).

4. Llenar la impresión (moldeo) o la férula con Master Temp. Aplicar primero el material en las áreas oclusales de la impresión o de la férula y llenar en dirección a las áreas gingivales.

5. Colocar la impresión o la férula rellena con la resina Master Temp sobre el diente preparado, al máximo 45 segundos después del inicio de la mezcla, aplicando una presión moderada, y fijarla.

6. El proceso de presa tiene que ser monitorizado intraoralmente (por ejemplo con una sonda), dado a que la polimerización sea afectada significativamente por la temperatura de la boca y la retirada del provisorio solamente es posible durante la fase elástica.

7. Quitar la camada de inhibición de oxígeno de la superficie del provisorio antes de la preparación (por ejemplo, con alcohol).

8. Aproximadamente 5 minutos después del inicio de la mezcla preparar el provisorio con una fresa de dientes cruzados, discos flexibles, etc.

9. Verificar la oclusión y, si necesario, rectificar con instrumentos adecuados.

10. Si necesario, aplicar en la superficie del provisorio un barniz de alto brillo fotopolimerizable o pulir manualmente con un pulidor de caucho o cepillo de cerdas de pelo de cabra.

11. Limpiar el coto, secar y quitar el lubricante.

12. Fijación del provisorio.

13. Verificar la oclusión y adaptar de forma correspondiente.

14. En la primera utilización de un cartucho expulsar una cantidad de material del tamaño de una arveja y desecharla.

15. Mezclar el material presionando la palanca en el dispensador/pistola en la puntera mezcladora y aplicar directamente.

16. Mantener la puntera mezcladora utilizada después de la aplicación en el cartucho para servir de tapa.

17. Retirada del cartucho:

1. Presionar la palanca en la parte posterior del dispensador/pistola para arriba y tirar la corrediza completamente para atrás.

2. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

3. Retirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

4. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

5. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

6. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

7. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

8. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

9. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

10. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

11. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

12. Tirar el pestillo de plástico para arriba y sacar el cartucho.

mascarilla facial y protección para los ojos para prevenir la entrada de polvo en los ojos y en las vías respiratorias.

- Los residuos de materiales a base de metacrilato pueden alterar el comportamiento de solidificación de materiales de impresión de silicona y de materiales de registro de mordida. Caso se haya procedido previamente a una restauración, limpiar cuidadosamente, antes del moldeo, el preparo y el tejido circundante con una gasa embebida en alcohol y agua rociada.
- Recoloque la tapa en el cartucho después de cada uso.

CONTRAINDICACIÓN

No utilizar este material en pacientes alérgicos o con hipersensibilidad a cualquier componen- te de la fórmula, especialmente metacrilato y monómeros relacionados.

EFFECTO ADVERSO

Hasta el momento no fue identificado ningún efecto adverso del producto. Ningún efecto colateral es esperado si el producto es usado de acuerdo con las instrucciones.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en local seco a temperatura ambiente de 15 °C (59 °F) a 25 °C (77 °F) y humedad del 80%.

PLAZO DE VALIDAD

La fecha de validez que consta en el paquete representa el plazo máximo para utilización del producto. No usar después de la fecha de validez.

MODO DE DESCARTE

No reutilizar el producto y desecharlo de acuerdo con la legislación local.

DESCRIPTION

Master Temp is a self-curing resin compos- ite for the fabrication of esthetic, long-last- ing temporaries for indirect procedures such as inlays, onlays, crowns, veneers and bridges. It is also indicated for the reline of prefabricated resin, polycarbonate or metal restorations, and also in mock-up procedures (prosthetic simulations, such as laminates).

INDICATION OF USE

- Fabrication of long-term esthetic temporaries, such as inlays, onlays, crowns, veneers and bridges.
- Refilling of prefabricated resin, polycar- bonate or metal restorations.
- Mock-up procedures (simulations of prosthetics, such as laminates).

PRESENTATIONS

Master Temp in colors: **A1, A2, A3, A3, 5, B1 and BLEACH.**

- Box with 1 cartridge of 75 g and 6 or 10 mixing tips.
- Box with 1 syringe with 7 g and 5 mixing tips.

COMPOSITION

Monomers, stabilizer, UV blocker, fluo- rescent agent, catalyst, fillers, initiators and pigments.

MODE OF USE

Recommended application

1. Before preparing the crown and bridge or an extraction, take an impression with alginate, silicone or a thermoplastic impression material. Alternatively, the provisional can also be made with a laboratory-prepared thermoformable tray or in the case of an individual crown with a composite crown. Strictly observe the manufacturer's instructions.
- Note:** When using a silicone impression, it is necessary to compensate the retentive zones and, if necessary, to open pressure relief grooves. To create a connection between the abutment teeth in the case of spaces in the molar region, a groove must be opened in the impression.
- 2.** Dry the prepared teeth and compensate for existing retentive areas in the prepara- tion. Then lightly lubricate the stumps and surrounding tissue and, if necessary, the

existing composite stump creations with vaseline or a similar lubricant.

- 3.** Select the desired resin shade and insert the respective cartridge into the dispens- er/pistol or use the respective syringe (see "Using the Automix cartridge" / see "Using the dual barrel syringe").

Note: To avoid bubble formation it is important that the mixing tip always remains immersed in the material during application. During filling keep excess material to a minimum.

- 4.** Fill impression or tray with Master Temp. Apply material to the occlusal areas of the impression or tray first and fill towards the gingival areas.

- 5.** Place the Master Temp resin filled impres- sion or tray onto the prepared tooth no later than 45 seconds after commence- ment of mixing, applying moderate pressure, and secure.

Note: The setting process has to be monitored intraorally (e.g. with a probe), as polymerization is significantly affected by the temperature in the mouth and removal of the temporary is only possible during the elastic phase.

- 6.** The temporary should be removed from the mouth during the elastic phase, i.e. within 1 min 30 s to 2 min 30 s after the start of mixing.

Note: To further improve the accuracy of large temporaries, they can be placed back into the impression until final polymeriza- tion after removal from the mouth.

- 7.** Remove the oxygen inhibition layer from the surface of the provisional before preparation (e.g. with alcohol).
- Caution!** When preparing the interim, it is possible for dust to get into the eyes and into the respiratory tract.
- Wear a face mask and goggles.
- Aspirate the dust and do not inhale it.

- 8.** Approximately 5 minutes after the start of mixing prepare the provisional with a cross-toothed cutter, flexible discs, etc.
- 9.** Check the occlusion and, if necessary, rectify with appropriate instruments.

- 10.** If necessary, apply a light-curing high gloss varnish to the surface of the provisional or polish it by hand with a rubber polisher or goat hair brush.
- 11.** Clean the stub, dry and remove the lubricant.

12. Attach the temporary.

Note: Any temporary cement can be used to fix the temporary. We recommend the use of eugenol-free cements. Cements contain- ing eugenol may impede polymerization of resin cements during definitive fixation.

- 13.** Check occlusion and adapt accordingly.

Customization and repair of Provisionals:

Note: When customizing and repairing newly created temporaries it is not necessary to sand or use an adhesive agent (continue with step 2).

Caution! When preparing the provisional, it is possible for dust to penetrate the eyes and airways.

- Wear a face mask and goggles.
- Aspirate the dust and do not inhale it.

- 1.** Repairing old temporaries: Lightly sand the temporary in place with a milling cutter or sandblast. Then apply an adhesive agent according to the manufacturer's instruc- tions for use.
- 2.** Apply Master Temp to all surfaces.
- 3.** Compress the parts for 3 minutes.
- 4.** After 5 minutes prepare the site as usual.

Notes: To speed up the polymerization it is possible to put the prepared part for a few minutes in hot water at a temperature of 50 °C (122 °F).

Using the Automix cartridge:

Insert cartridge:

- 1.** Press the lever at the back of the dispens- er/pistol upward and pull the slide all the way back.

- 2.** Pull up the plastic latch, insert the cartridge and lock with the plastic latch.

Note: Make sure that the grooves on the cartridge match those on the dispens- er/pistol.

Apply the mixing nozzle:

- 1.** Remove and discard the used cartridge cap or mixing cannula after 90° counter- clockwise rotation.
- 2.** Apply a new mixing nozzle.
- Note:** Make sure that the grooves on the mixing cannula match those on the cartridge.
- 3.** Lock the mixing nozzle by turning it 90° clockwise.

Material Application:

- 1.** On the first use of a cartridge expel a

pea-sized amount of material and discard.

- 2.** Mix the material by pressing the lever on the dispenser/pistol into the mixing tip and apply directly.

Note: Keep the mixing tip used after application in the cartridge to serve as a cap.

Removing the cartridge:

- 1.** Press the lever at the back of the dispens- er/pistol upward and pull the slide all the way back.

- 2.** Pull up the plastic latch and remove the cartridge.

Using the dual barrel syringe:

- 1.** Before applying the mixing tip remove the cap or used mixing tip by turning it 90° counterclockwise and discard.

- 2.** Apply a new mixing tip.
- Note:** Make sure that the grooves on the dual barrel syringe match those on the mixing tip.

- 3.** Lock the tip by turning it 90° clockwise.
- 4.** On first use of a syringe expel a pea-sized amount of material and discard.
- 5.** The material is mixed in the tip during expulsion and can be applied directly.

Notes: Keep the used mixing tip after application in the dual barrel syringe to serve as a cap.

Timing:

Placing in the mouth:

0 - 45 min

Removal from the mouth:

1 min 30 s - 2 min 30 s

End of polymerization:

5 min

Preparing the Provisional:

Warning: The times indicated apply at an ambient temperature of 23 °C (73 °F) and a relative humidity of 50%. Higher tempera- tures reduce these times and lower temperatures increase them.

WARNINGS

- Avoid the use of Master Temp in patients with a history of allergy to acrylate-based resin composites. In case of allergic reactions to the product, discontinue use and ask the patient to seek medical attention.
- Contact of unpolymerized Master Temp

with skin, mucous membranes and eyes should be avoided. When still unpolymer- ized, the product may cause a mild irritant effect and promote sensitization to methacrylates.

- The product may cause some level of irritation if in contact with and/or very close to the dental pulp.
- To avoid allergic reactions to the methac- rylate monomer, the constant use of gloves is recommended. If Master Temp comes into contact with the hands, wash with plenty of water.
- In case of contact with the eyes, rinse them thoroughly with running water and contact a physician immediately.
- Master Temp should not be swallowed or aspirated. In case of ingestion or aspiration, seek medical attention immediately.
- Do not leave Master Temp within reach of children.

ADVERSE EFFECT

To date, no adverse effects of the product have been identified. No side effects are expected if the product is used according to instructions.

STORAGE CONDITIONS

Store in a dry place at room temperature of 15 °C (59 °F) to 25° C (77 °F) and humidity of 80%.

VALIDITY

The expiration date on the packaging represents the maximum time the product can be used. Do not use after the expiration date.

DISPOSAL

Do not reuse the product and dispose of it according to local legislation.

PRECAUTIONS

- Use Master Temp as stated in these instructions.
- The product is indicated for professional use only.
- To eliminate the risk of irritation, areas very close to the pulp should receive adequate protection (application of Calcium Hydroxide-based liners, for example). Avoid using Eugenol-based materials with Master Temp. Cements containing eugenol may impede the polymerization of resin cements during definitive fixation.
- During preparation of the provisional wear a face mask and eye protection to prevent dust from entering the eyes and airways.
- Residual methacrylate-based materials may alter the solidification behavior of silicone impression materials and bite registration materials. If a restoration has been previously placed, thoroughly clean the preparation and surrounding tissue with an alcohol and water sprayed gauze prior to impression-taking.
- Replace the cap on the cartridge after each use.

CONTRAINDICATION

Do not use this material in patients allergic or hypersensitive to any component of the formula, especially methacrylate and related monomers.

	Manter seco. Mantener seco. Keep dry.
	Fabricante. Fabricante. Manufacturer.
	Consulte as instruções para utilização. Consultar instrucciones de uso. Consult instructions for use.
	Código do lote. Código del lote. Batch code.
	Manter afastado da luz solar. Manténgalo lejos de la luz solar. Keep away from sunlight.
	Número do catálogo. Número del catálogo. Catalogue number.
	Cuidado Caution. Consultar as instruções de uso para informações preventivas importantes. Consultar las instrucciones de uso para obtener información preventiva importante. Consult instructions for use for important preventive information.
	Não reutilizar. No lo reutilice. Do not re-use.
	Validade. Validez. Use – by date.
	Limite de temperatura. Limite de temperatura. Temperature limit.

Fabricante | Manufacturer: Maquira Indústria de Produtos Odontológicos S.A.
CNPJ: 05.823.205/0001-90
Endereço | Dirección | Address: Av. Melvin Jones, 773
Pq. Ind. Bandeirantes
Maringá - PR | 87070-030 | Brasil
Resp. Técnico | Technical Resp.: Cristiane Furlan | CRF-PR: 14.038
Reg. ANVISA N°: 80322409014

SAP:
Atendimento ao cliente
Atención al cliente
Customer service
0800 726 5848
sap@maquira.com.br

Aproximadamente 5.430 resultados (0,45 segundos)

Exibindo resultados para **preço zirconfill**
Em vez disso, pesquisar por **preço zirconfill**

Patrocinado

PROMOÇÃO

Resina Zirconfill DB1...
R\$ 47,99 ~~R\$ 69~~
Dental Cremer

PROMOÇÃO

Resina Zirconfill E-...
R\$ 47,99 ~~R\$ 69~~
Dental Speed

PROMOÇÃO

Resina Zirconfill 4 G ...
R\$ 46,00 ~~R\$ 69~~
Surya Dental

PROMOÇÃO

Resina Zirconfill EA3...
R\$ 51,99 ~~R\$ 69~~
Dental Speed

Resina Zirconfill...
R\$ 49,90
Dental Cremer

Resina Composta...
R\$ 46,00
Dental Med Sul

Resina A3,5 Dentina...
R\$ 50,00
Surya Dental

>
Ver tud

Patrocinado

Dental Cremer
https://www.dentalcremer.com.br

Resina Composta Zirconfill BM4 | Dental Cremer

Só a maior Dental da América Latina te traz as melhores ofertas. Confira! Tudo em...
Classificação de dentalcremer.com.br: 4,8 - 2.422 comentários

[Kits Econômicos](#) · [Ofertas do Mês](#) · [Dental Cremer Lovers](#) · [Simples Dental](#)

[Kit Resina e Adesivo - 3M](#) - R\$ 742,99 - *Economize + de R\$ 600 · [Mais](#) ▾

Patrocinado

Dental Speed
https://www.dentalspeed.com

Resina Zirconfill - DA2 - Maquira

Portfólio completo de materiais descartáveis. Acesse já. Envio rápido para todo o Brasil e...

Dental Cremer
https://www.dentalcremer.com.br › resina-zirconfill-bm...

Resina Zirconfill - BM4

Resina Zirconfill da BM4 nanohíbrida em seringa com 4g para restaurações estéticas em dentes anteriores e posteriores com ótimo **preço**. Compre agora!

Avaliação: 5 · 100 comentários · **R\$ 47,99** · **Em estoque**

Dental Speed
https://www.dentalspeed.com › resina-zirconfill-maquir...

Resina Zirconfill - Maquira

Resina composta nano-híbrida, fotopolimerizável e radiopaca; · Sistema de cores composto de quatro níveis de translucidez (Opaco, Dentina, Esmalte e Translúcido) ...

Avaliação: 5 · 100 comentários · **R\$ 68,90** · **Em estoque**

Surya Dental
https://www.suryadental.com.br › ...

Resina Zirconfill 4 g - BM4

A Resina composta **Zirconfill** é nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca, desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores com alto ...

R\$ 46,00

As pessoas também perguntam

Como usar a resina composta?

BM4 Resina Zirconfill

(1)

Detalhes

Comentários

Loja



Cor ▾

Dental Speed
Resina Zirconfill EA2 4...
R\$ 51,99 ~~R\$ 69~~
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 30 entre 22 – 26 de mar. · Grátis a partir de R\$ 199,01
Até 7 dia(s)

Dental Cremer
Resina Zirconfill - BM4
R\$ 47,99 ~~R\$ 69~~
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 30 entre 21 – 26 de mar. · Grátis a partir de R\$ 200,01
Até 7 dia(s)

Dental Med Sul
Resina Composta...
12x de R\$ 3,83 - sem juros
R\$ 46,00
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 20 entre 18 – 22 de mar. · Grátis a partir de R\$ 99,01
Até 7 dia(s)

Dental Speed
Resina Zirconfill EC2 -...
R\$ 47,99 ~~R\$ 69~~
Em estoque on-line
Entrega por R\$ 30 entre 22 – 26 de mar. · Grátis a partir de R\$ 199,01
Até 7 dia(s)



×



DESCRIPTION: Zirconfill is a nano-hybrid, light curable and radiopaque composite resin. Zirconfill has been developed to be used in the restoration of anterior and posterior teeth. It has a high content of inorganic filler (80% in weight). The filler content is mainly composed of zirconium/silica particles. The particle size distribution allows the adequate filling of the resin, contributing to its high mechanical resistance and wear resistance, and to the easy polishing; creating a restoration with smooth surface and high shine. It presents high workability and ideal consistence. It sets in the dental cavity, or in models, by the use of direct halogen light or LED.

TECHNICAL DATA:

Average particle size: 15,8 micrometers
Average nanoparticle size: 20 nanometers
Average percentage of filler in weight: 80%

INDICATIONS:

Zirconfill has been developed to be used in the restoration of anterior and posterior teeth. It is indicated to be used in: Direct restoration of the enamel and dentin, of all classes (I, II, III, IV e V); Esthetic corrections; Direct composite veneers; Tooth fragment bonding; Indirect restorations (inlays e onlays); Confection of core resin buildups; Anterior teeth stabilization.

PRESENTATION: Syringe with 4g of the product, in the below listed colors:

Opaque: OA2 | OA3

Dentin: DA1 | DA2 defina universal | DA3 | DA3,5 | DA4 | DB1
DB2 | DB3 | DC2 | DC3 | D-Bleach

Enamel: EA1 | EA2 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2

EC3 | E-Bleach H | E-Bleach M | E-Bleach L

Translucent: T-Neutral | T-Blue | T-Yellow | T-Orange | T-Gray

COMPOSITION: Mixture of Monomers (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA and UDMA), Photo initiator, Diatomite, Silica, Zirconia/Silica, Mixed Oxide and Colorants.

INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Perform the prophylaxis of the teeth's surfaces. For that procedure, avoid the use of substances containing oil vehicle and/or fluoride. 2. Choose the appropriate color of the restorative material. For purposes of the color selection, the teeth must be clean and hydrated, without any isolation. 3. Perform the isolation of the operative field. The isolation must guarantee a moisture-free, clean and visible operative field, during all treatment. Preferably, use rubber dam isolation. 4. Prepare the cavity according to the recommendation for the execution of direct adhesive restorations. 5. Perform pulp protection, if necessary, with lining material based on calcium hydroxide and/or glass ionomer, according to the professional's clinical evaluation and following the instructions for use of these materials. 6. For anatomical restoration of the teeth and, in order to minimize the excess resin to be removed, universal or pre-formed polyester matrixes must be used. The use of wedges will make the adaptation of matrixes and the achievement of proximal contact easier. 7. Perform the acid etching, following the instructions for use of the material that will be used. 8. Apply the adhesive system, according to the manufacturer's recommendations. 9. Perform the cavity restoration, using an adequate instrument to apply the increments of Zirconfill, carefully adapting them to the cavity walls. 10. We recommend the technique of insertion and polymerization by increment. This technique allows a more uniform polymerization. Use the maximum increment thickness and polymerization time, described in the chart below:

COLORS	Maximum increment thickness	polymerization time
Dentin Opaque	1,5 mm	30 s
Enamel Translucent	2,0 mm	20 s

11. Light-cure each increment, as described in the chart above. Note that the presented values are ideal when light curing units with wavelength of 400 a 500nm are used. These values must be adjusted according to the equipment used by the professional. 12. If matrixes are used for the confection of the restoration, at the end of the execution and after removing the matrix, the last layer of resin must be submitted to an additional polymerization. 13. Check the occlusion with articulation paper. Carefully adjust the occlusion. 14. Perform finishing and contouring of the surface of the restoration. Finishing, contouring and occlusal adjust must be performed with instruments of choice of the professional, such as fine grit diamond burs, scalpel blades, silicone points, etc. Proximal surface contouring must be performed with sandpaper strips. 15. Perform polishing with sandpaper disc, felt discs and polishing pastes, of choice of the professional.

PRECAUTIONS: The product is manufactured to be used only as exposed in the instructions for use. The use in a different way than described in the instructions for use is of single and exclusive responsibility of the professional. Product is for Professional dental use. These resins are light sensitive. For this reason, too intense ambient lights may cause the premature polymerization of the material. Avoid intense light in the operative field. After removing the resin from the syringe, use it fast. And immediately replace the syringe cap. After use, the product must be properly closed. Contact with saliva or blood during the application of resin might damage the restoration. The use of rubber dam or cotton rolls, along with saliva ejector, is recommended for adequate isolation. Avoid the use of lining or temporary materials based on eugenol, because they may interfere in the setting of the resin. Use masks, gloves and goggles for appropriate protection. It is also recommended that patients wear protective goggles too. Do not allow product to come contact with oral tissues or the skin. Do not use the product with expired validity. Cationic mouth solutions may cause discoloration, same as plaque disclosures and chlorhexidine. Do not use in patients with hypersensitivity to the components of the product. Keep out of reach of children. Single use product. Prohibited reprocessing.

RESTRICTIONS, WARNINGS OR CONTRAINDICATIONS: There is no contraindication, when Zirconfill is used by a dental professional, according to the instructions for use. However, in patients with history of allergy to any components of the formula, the use is not recommended. In case of allergic reaction, stop the use and seek medical attention. **EXPIRATION DATE:** The expiration date is described in the packaging and represents the maximum deadline for use of the product. Do not use after the expiration date.

STORAGE:

Product must be kept in the original packaging, which must be closed after use. Keep it protected from direct light incidence. Keep at temperatures between 5 and 30°C, in a dry place. If product is kept under refrigeration, it must be removed from the refrigerator before use, to allow it to return to room temperature. Under adequate storage conditions, Zirconfill has a shelf life of 36 months.



zirconfill

	Consultar as informações de segurança, perigos e precauções. Please review safety information, hazards and precautions. Consultar la información de seguridad, peligros y precauciones.
	Manter seco. Keep dry. Mantener seco.
	Manter ao abrigo do sol Keep away from sunlight Mantener al abrigo del sol
	Read usage instructions Leer las instrucciones de uso Lire le mode d'emploi
	Recyclable paper Papel reciclable Papier recyclable
	Limites de temperatura Limites de temperatura Temperature limite

maquira



Fabricado por / Manufactured by:

Maquira Indústria de Produtos

Odontológicos S.A.

CNPJ: 05.823.205/0001-90

Av. Melvim Jones, 773 - Parque Industrial

Bandeirantes - 87070-030 Maringá - PR

Farm. Responsável / Responsable Pharm /

Responsable Farm.:

Kellen Dib de Campos - CRF/PR: 15.807

Registro ANVISA nº: 80322400121

Data de Revisão / Rev. Date / Fecha de rev.:

19/12/2019 rev.00

DESCRIÇÃO: Zirconfill é uma resina composta nanohíbrida, fotopolimerizável e radiopaca. A resina Zirconfill foi desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. Tem alto teor de carga inorgânica (80% em peso), sendo esta carga formada, principalmente, de partículas de zircônio/silíce. A distribuição do tamanho das partículas permite um preenchimento adequado da resina contribuindo para sua elevada resistência mecânica e resistência ao desgaste, e para a facilidade de polimento; gerando uma restauração com superfície lisa e de alto brilho. Apresenta alta trabalhabilidade e consistência ideal. Polimeriza na cavidade dental, ou em modelos, com a utilização direta de luz halógena ou LED.

DADOS TÉCNICOS:

Tamanho médio das partículas: 15,8 micrômetros
Tamanho médio das nanopartículas: 20 nanômetros
Percentual médio de cargas em peso: 80%

INDICAÇÕES: A resina Zirconfill foi desenvolvida para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. É indicada para uso em: Restaurações diretas do esmalte e dentina, de todas as classes (I, II, III, IV e V); Correções estéticas; Facetas diretas em resina composta; Colagem de fragmentos de dentes; Restaurações indiretas (inlays e onlays); Confeção de núcleo de preenchimento; Estabilização de dentes anteriores.

APRESENTAÇÃO: Seringa contendo 4g do produto, nas cores descritas abaixo:

Opaco: OA2 | OA3

Dentina: DA1 | DA2 dentina universal | DA3 | DA3,5 | DA4 | DB1

DB2 | DB3 | DC2 | DC3 | D-Bleach

Esmalte: EA1 | EA2 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2

EC3 | E-Bleach H | E-Bleach M | E-Bleach L

Translúcido: T-Neutro | T-Blue | T-Yellow | T-Orange | T-Grey

COMPOSIÇÃO: Mistura de Monômeros (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA e UDMA), Fotoiniciador, Diatomita, Silíce, Óxido Misto de Zircônio, Silíce e Pigmentos.

INSTRUÇÕES DE USO: 1. Efetuar profilaxia das superfícies dentais. Evitar, para este procedimento, o emprego de substâncias contendo veículo oleoso e/ou fluoratos. 2. Selecionar a cor apropriada do material restaurador. Para a seleção da cor, os dentes devem estar limpos e hidratados, sem isolamento. 3. Promover o isolamento do campo operatório. O isolamento deve garantir um campo operatório livre de umidade, limpo e visível durante todo o tratamento. Preferencialmente, utilizar isolamento absoluto. 4. Preparar a cavidade de acordo com as recomendações para a execução de restaurações adesivas diretas. 5. Efetuar a proteção pulpar, quando necessário, com material forrador a base de hidróxido de cálcio e/ou ionômero de vidro, de acordo com a avaliação clínica do profissional, e seguindo as instruções de uso destes materiais. 6. Para restaurar anatomicamente os dentes e minimizar os excessos a serem removidos, devem-se utilizar matrizes universais ou pré-formadas de poliéster. O uso de cunhas facilitará a adaptação da matriz e a obtenção de contatos proximais adequados. 7. Fazer o condicionamento ácido, seguindo as instruções de uso do produto utilizado. 8. Aplicar o sistema adesivo de acordo com as recomendações do fabricante. 9. Restaurar a cavidade, utilizando um instrumento adequado para aplicar os incrementos da resina Zirconfill, adaptando-os cuidadosamente às paredes cavitárias. 10. Recomendamos a técnica de inserção e polimerização por incremento. Essa técnica permite uma polimerização mais uniforme. Utilize as espessuras máximas de incremento e os tempos de polimerização descritos na tabela abaixo:

CORES	Espessura máxima de incremento	Tempo de polimerização
Dentina / Opaco	1,5 mm	30 s
Esmalte / Translúcido	2,0 mm	20 s

11. Fotopolimerizar cada incremento conforme descrito na tabela acima. Note-se que os valores apresentados são ideais quando se utiliza aparelhos fotopolimerizadores que emitem luz visível com comprimento de onda de 400 a 500nm. Estes valores podem ser ajustados de acordo com o equipamento utilizado pelo profissional. 12. Se matrizes forem utilizadas para a confecção da restauração, ao final da execução e após a remoção da matriz, a última camada de resina deve ser submetida à polimerização adicional. 13. Verificar a oclusão com papel de articulação. Ajustar cuidadosamente a oclusão. 14. Dar acabamento e contorno à superfície da restauração. O acabamento, contorno e ajuste oclusal devem ser feitos com instrumentos de escolha do profissional, tais como pontas diamantadas de granulação fina para acabamento, lâminas de bisturi, pontas de silicone, etc. O contorno da superfície proximal deve ser feito com tiras de lixa de acabamento e polimento. 15. Dar polimento à restauração com discos de lixa, discos de feltro e pastas para polimento, a critério do profissional.

PRECAUÇÕES: O produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto nas instruções de uso. O uso de forma distinta das instruções de uso é de única e exclusiva responsabilidade do profissional que a utilize. O produto é de uso Odontológico Profissional. Estas resinas são sensíveis à luz. Portanto, luzes ambientes demasiadamente intensas podem provocar uma polimerização prematura. Evite luz intensa no campo de trabalho. Após retirar da seringa, utilize a resina rapidamente. E reponha a tampa protetora na seringa, imediatamente. Após o uso, o produto deverá ser devidamente fechado. O contato com a saliva e com sangue durante a aplicação da resina, pode prejudicar a restauração. Recomenda-se o uso de isolamento absoluto ou roletes de algodão, associado ao sugador de saliva, para adequado isolamento. Evite a utilização de materiais forradores ou provisórios à base de eugenol, pois estes interferem na polimerização da resina. Use máscara, luvas e óculos para proteção apropriada. Recomenda-se que os pacientes também utilizem óculos de proteção. Não permitir o contato do produto com tecidos orais ou com a pele. Não use o produto com validade vencida. Soluções bucais cáttionicas podem causar decoloração, assim como reveladores de placas e clorhexidina. Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade aos componentes do produto. Mantenha fora do alcance de crianças. Produto de uso único. Proibido reprocessar.

RESTRICÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CONTRAINDICAÇÕES: Não há contraindicação, quando as resinas Zirconfill são usadas por um profissional de odontologia, de acordo com as instruções de uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia aos componentes da fórmula, recomenda-se não fazer o uso. Em casos de reação alérgica ao produto, suspenda o uso e procure assistência médica.

VALIDADE: A data de validade que consta das embalagens representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após a data de validade.

ARMAZENAMENTO: O produto deve permanecer em sua embalagem original, que deve ser fechada após o uso. Proteger da incidência de luz direta. Armazenar em temperaturas de 5 a 30°C, em local seco. Caso o produto seja armazenado sob refrigeração, o mesmo deve ser retirado do refrigerador antes do uso, para retornar à temperatura ambiente. Sob condições adequadas de armazenamento, Zirconfill tem uma validade de 36 meses.

DESCRIPCIÓN: Zirconfill es una resina compuesta nanohíbrida, fotopolimerizable y radiopaca. Zirconfill se desarrolló para emplearse en la restauración de dientes anteriores y posteriores. Tiene un alto contenido de relleno inorgánico (80 % en peso). El contenido de relleno se compone principalmente de partículas de circonio o sílice. La distribución del tamaño de partícula permite el relleno adecuado de la resina, lo cual contribuye a su alta resistencia mecánica y resistencia al desgaste, y al pulido fácil, creando una restauración con superficie lisa y brillo intenso. Presenta viabilidad alta y consistencia ideal. Se fija en la cavidad dental, o en modelos, mediante el uso de luz halógena directa o LED.

DATOS TÉCNICOS: Tamaño medio de partícula: 15,8 micrómetros. Tamaño medio de nanopartícula: 20 nanómetros. Porcentaje medio de relleno en peso: 80 %.

INDICACIONES: Zirconfill se desarrolló para emplearse en la restauración de dientes anteriores y posteriores. Está indicado para emplearse en lo siguiente: Restauración directa del esmalte y la dentina de todas las clases (I, II, III, IV y V); Correcciones estéticas; Carillas de compuesto directas; Unión de fragmentos de dientes; Restauraciones indirectas (incrustaciones y recubrimientos); Confección de reconstrucciones con resina del núcleo; Estabilización de dientes anteriores.

PRESENTACIÓN: Jeringa con 4 g de producto, en los siguientes colores:

Opaco: OA2 | OA3

Dentina: DA1 | DA2 dentina universal | DA3 | DA3,5 | DA4 | DB1

DB2 | B3 | DC2 | DC3 | D-Bleach

Esmalte: EA1 | EA2 | EA3 | EA3,5 | EA4 | EB1 | EB2 | EB3 | EC2

EC3 | E-Bleach H | E-Bleach M | E-Bleach L

Translúcido: T- neutro | T- azul | T- amarillo | T- naranja | T- gris

COMPOSICIÓN: Mezcla de monómeros (Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA y UDMA), fotoiniciador, diatomita, sílice, circonio o sílice, óxido mixto y colorantes.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Realice la profilaxis de las superficies de los dientes. Para ese procedimiento, evite el uso de sustancias que contengan vehículo de aceite o fluoruro. 2. Elija el color adecuado del material restaurador. Para elegir el color, los dientes deben estar limpios e hidratados, sin ningún tipo de aislamiento. 3. Realice el aislamiento del campo de operaciones. El aislamiento debe garantizar un campo de operaciones seco, limpio y visible, durante todo el tratamiento. Preferiblemente, use un dique de goma como aislamiento. 4. Prepare la cavidad de acuerdo con la recomendación para la ejecución de restauraciones adhesivas directas. 5. Realice la protección pulpar, de ser necesario, con material de revestimiento a base de hidróxido de calcio o ionómero vítreo, de acuerdo con la evaluación clínica del profesional y siguiendo las instrucciones de uso de estos materiales. 6. Para la restauración anatómica de los dientes y, para minimizar el exceso de resina a eliminar, se deben emplear matrices de poliéster preformadas o universales. El uso de cuñas facilitará la adaptación de las matrices y el logro del contacto proximal. 7. Realice el grabado al ácido, siguiendo las instrucciones de uso del material que se empleará. 8. Aplique el sistema adhesivo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 9. Realice la restauración de la cavidad, empleando un instrumento adecuado para aplicar los incrementos de Zirconfill, amoldándolos cuidadosamente a las paredes de la cavidad. 10. Recomendamos la técnica de inserción y polimerización por incremento. Esta técnica permite una polimerización más uniforme. Use el espesor máximo de incremento y el tiempo de polimerización, tal como se describe en la tabla a continuación:

COLORES	Espesor máximo de incremento	Tiempo de polimerización
Dentina / Opaco	1,5 mm	30 s
Esmalte / Translúcido	2,0 mm	20 s

11. Fotopolimerice cada incremento, tal como se describe en la tabla anterior. Tenga en cuenta que los valores indicados son ideales cuando se emplean unidades de fotopolimerización con una longitud de onda de 400 a 500 nm. Estos valores deben ajustarse de acuerdo con el equipo que emplee el profesional. 12. Si se emplean matrices para la confección de la restauración, al final de la ejecución y después de retirar la matriz, la última capa de resina debe someterse a una polimerización adicional. 13. Verifique la oclusión con papel articular. Ajuste la oclusión cuidadosamente. 14. Realice el acabado y el contornoado de la superficie de la restauración. El acabado, contorno y ajuste oclusal deben ser hechos con los instrumentos elegidos por el profesional, como fresas de diamante de grano fino, hojas de bisturi, puntas de silicona, etc. El contornoado de la superficie proximal debe realizarse con tiras de papel de lija. 15. Realice el pulido con disco de papel de lija, discos de fieltro y pastas para pulir, a elección del profesional.

PRECAUCIONES: El producto está fabricado para emplearse solamente de la forma que se indica en las instrucciones de uso. Su uso en una manera diferente a la descrita en las instrucciones de uso es responsabilidad única y exclusiva del profesional. El producto es para uso odontológico profesional. Estas resinas son sensibles a la luz. Por esta razón, las luces demasiado intensas del ambiente pueden causar la polimerización temprana del material. Evitar la luz intensa en el campo de operaciones. Una vez que retire la resina de la jeringa, úsala rápidamente. Reemplace inmediatamente la tapa de la jeringa. Después de su uso, el producto debe estar bien cerrado. El contacto con saliva o sangre durante la aplicación de resina puede dañar la restauración. Se recomienda el uso de diques de goma o rollos de algodón, junto con el eyector de saliva, para un aislamiento adecuado. Evitar el uso de revestimientos o materiales temporales a base de eugenol, ya que pueden interferir en la fijación de la resina. Usar máscara, guantes y gafas para una protección adecuada. También se recomienda que los pacientes usen gafas protectoras. No permitir que el producto entre en contacto con los tejidos orales o la piel. No utilizar el producto una vez que su validez haya expirado. Las soluciones cáttionicas bucales pueden causar decoloración, así como los reveladores de placa y la clorhexidina. No usar en pacientes con hipersensibilidad a los componentes del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto de un solo uso. Prohibido el reprocesamiento.

RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS O CONTRAINDICACIONES: No hay contraindicaciones cuando un profesional odontológico emplea Zirconfill de acuerdo con las instrucciones de uso. Sin embargo, no se recomienda su uso en pacientes con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula. En caso de reacción alérgica, suspender el uso y buscar asistencia médica.

FECHA DE CADUCIDAD: La fecha de caducidad se indica en la presentación y representa la fecha límite máxima para el uso del producto. No usar después de la fecha de caducidad.

ALMACENAMIENTO: El producto debe mantenerse en su presentación original, la cual debe cerrarse después de su uso. Debe mantenerse protegido de la incidencia directa de la luz. Mantener a temperaturas de entre 5 y 30 °C, en un lugar seco. Si el producto se mantiene refrigerado, debe retirarse del refrigerador antes de su uso para permitir que vuelva a temperatura ambiente. En condiciones de almacenamiento adecuadas, Zirconfill tiene una vida útil de 36 meses.

Ofertas selecionadas especialmente para você. Confira!

[Início](#) > Resultados da busca por:

Você quis dizer: zircofill

Itens 1 - 1 de 1



Ordenar por

Relevância



Resina Zircofill - BM4

Resina Nanohíbrida. Embalagem com 1 seringa com 4g.
Escolha a cor.

~~R\$68,90~~ 30% OFF

R\$47,99

Confira itens*

[Ver Opções](#)

Produtos por página

24

1

Copyright © 2023 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2º andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG nº 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.





Home > Cimentos > Cimento Resinoso > Cimento Resinoso Dual Force Corpo Duplo - Maquira

1/3



Cimento Resinoso Dual Force Corpo Duplo - Maquira

Kit com 5g (corpo duplo: 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiras. Escolha a cor.

Cod. de Referência: DC25499

★★★★★ (5)

Escolha uma opção *

Escolha uma opção...

R\$89,90

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+ Adicionar a lista de desejos ▾

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

♥ **Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.

🚚 **Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.

↔ **Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento ▾

Detalhes ^

- * Cimento resinoso adesivo permanente.
- * Cura dual: química e fotoativada.
- * Composto por duas pastas (base e catalisadora) que devem ser utilizadas na proporção 1:1.
- * Alta capacidade adesiva.
- * Alta resistência flexural.
- * Alto grau de conversão de cura química e dual.
- * O corpo duplo permite maior facilidade na aplicação do produto e homogeneização.
- * Ótima radiopacidade.
- * Ponteiras de automistura devem ser descartadas após o uso para evitar a infecção cruzada.
- * Registro ANVISA: 80322400096.

Aplicação ▾

Informações Adicionais



Aproveite Agora



Cimento Resinoso Dual Force Corpo Duplo - Maquira

Kit com 5g (corpo duplo: 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros. Escolha a cor.



R\$89,90

Selecione

Leve também









Ponta Diamantada Esférica FG - AllPrime

Embalagem com 1 unidade. Escolha o modelo.



R\$5,29

Selecione





Sugador Descartável Transparente - AllPrime

Embalagem com 40 unidades.



~~R\$8,99~~ 21% OFF

R\$6,99

ECONOMIZE R\$1,91

R\$104,09
R\$102,18

Comprar todos

Produtos Visitados Por Quem Procura este Item



15/03/24, 18:09

Cimento Resinoso Dual Force Corpo Duplo – Maquira



Kit Cimento Resinoso Dual Superpost Cement+ - Superdont

Kit com 1,5g de Base + 1,5g de Catalisador.

★★★★★

R\$50,90

- 1 +

Adicionar



Cimento Resinoso Dual Force Catalisador - Maquira

Embalagem com 2,5g + 3 ponteiros.

★★★★★

R\$49,90

- 1 +

Adicionar



Cimento Resinoso Dual All-cem Base - FGM

Embalagem com 2,5g de Base. Escolha a cor.

★★★★★

R\$71,90

Ver Opções



Kit Cimento Resinoso Dual Superpost Cement+ - Superdont

Kit com 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador.

★★★★★

R\$74,90

- 1 +

Adicionar



Cimento Resinoso Dual Cement - Vigor

Kit com 1 seringa de 2,5 na cor U + 1 seringa com

★★★★★

~~R\$83,90~~ 21% OFF
R\$65,90 + 2 ♥

- 1 +

Adicionar

Quem Viu este Produto, Comprou esses:

<https://www.dentalcremer.com.br/cimento-resinoso-dual-force-corpo-duplo-maquira-dc25499.html>

5/8



Cimento Resinoso Dual Force Corpo Duplo - Maquira

Kit com 5g (corpo duplo: 2,5g de Base + 2,5g de Catalisador) + 5 Ponteiros. Escolha a cor.



R\$89,90

Ver Opções

10% compraram



10% compraram



9% compraram



7% compraram



6% compraram



Luva de Procedimento de Látex com Pó - Supermax

Embalagem com 100 unidades. Escolha o tamanho.

★★★★★

A partir de **R\$36,99**

Confira regra*

Ver Opções

Rolo Dental - SSPlus

Embalagem com 100 unidades.

★★★★★

R\$2,90

— 1 +

Adicionar

Aplicador - AllPrime

Embalagem com 100 unidades. Escolha o modelo.

★★★★★

~~R\$16,90~~ 29% OFF

R\$11,99

Ver Opções

Condicionador Ácido Fosfórico 37% - AllPrime

Embalagem com 3 Seringas de 2,5ml cada e 3 ponteiros para...

★★★★★

~~R\$6,90~~ 42% OFF

R\$3,99

— 1 +

Adicionar

Sugador Descartável - AllPrime

Embalagem com 40 unidades.

★★★★★

~~R\$8,90~~ 21% OFF

R\$6,99

— 1 +

Adicionar

Tire dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas. Faça a primeira!

Fazer uma pergunta

Avaliações deste produto



60% recomendam este produto

Ordenar

Avaliar produto



Regular!

Sobre o produto em si não tenho como avaliar sua resistência, mas sua embalagem e seu sistema é pouco prático, vem com apenas 4 pontas aplicadoras, ou seja, dá para usar poucas vezes, acabando as pontas a seringa não funciona bem. O fabricante diz que mantém uma média de pontas para uso pela quantidade de produto, mas em cimentação de pinos de fibra a quantidade de porção é muito pequena. Enfim, pouco prático. Talvez as seringas separadas sejam melhores.

Antonio J. 14/12/2023

- ✔

 Compra verificada
- ✖

 Não recomendaria este produto a um amigo.
- 👍

 Útil? (0)



Bom!

Dentre os cimentos dual com reforço do mercado eu super indico. Custo benefício é muito fácil de aplicação. Ele é mais fluido que outros do mercado, tendo um tempo de presa mais lento, mas tem me trazido grandes resultados. Indico!!!

Rafael O. 02/02/2023

- ✔

 Compra verificada
- ✔

 Sim, recomendaria este produto a um amigo.
- 👍

 Útil? (-2)



Muito bom!

gostei do cimento, bom preço

Fabricao G. 27/09/2022

- ✔

 Compra verificada
- ✔

 Sim, recomendaria este produto a um amigo.
- 👍

 Útil? (-1)





Muito bom!

gostei

Ricardo C. 23/09/2022

 Compra verificada

 Sim, recomendaria este produto a um amigo.

 Útil? (1)



Muito ruim!

Péssimo, n recomendo o produto. Ao apertar p sair com a ponta misturadora n regula a saída e atrasa material, fluido, acaba em poucas aplicações .

Any C. 02/09/2022

 Compra verificada

 Não recomendaria este produto a um amigo.

 Útil? (-1)

Carregar mais avaliações

Copyright © 2023 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2º andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG nº 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.



[INÍCIO](#) | [CIMENTOS](#) | [PRODUTOS](#) | [CIMENTO RESINOSO DUAL FORCE](#)

CIMENTO RESINOSO DUAL FORCE

CIMENTOS

Dual Force é um cimento resinoso de cura dual (fotoativada e química), de uso profissional, indicado para cimentação adesiva de pinos intrarradiculares e restaurações à estrutura dental. O produto é composto por pasta base e catalisadora, que devem ser usados na proporção 1:1.

REG. ANVISA N°: 80322400096

Indicações

+

Apresentações

-

Pasta base – Disponível nas cores: **A1, A2, A3** e **Transparente** | 1 Seringa com 2,5 g e 3 ponteiras.

Pasta catalisadora – 1 Seringa com 2,5 g e 3 ponteiras.

Pasta base + pasta catalisadora – 1 Seringa corpo duplo com 2,5 g de pasta base (**A1, A2, A3** e **Transparente**), 2,5 g de pasta catalisadora e 5 ponteiras.

Downloads

+

- INÍCIO
- PRODUTOS
- CATÁLOGOS
- CONTATO
- INSTRUÇÕES DE USO
- TRABALHE CONOSCO
- POLÍTICA DE PRIVACIDADE

environment. It is compatible with all adhesives and resins. It has radiopaque characteristics. The light curing time is 20 seconds.

USE INSTRUCTIONS:

I - Definitive esthetic restorations as a initial layer:

1. Make the crown polishing with pumice powder and water;
2. Accomplish the clinical procedures of cavity preparation according to required technique;
3. Select the color with hydrated teeth;
4. Place rubber dam;
5. Apply the 37% Orthophosphoric Acid (a.e. Ataque Gel) during 15 seconds for dentin and 30 seconds for enamel.
6. Rinse thoroughly with water for 30 seconds;
7. . Dry the dentin (without dehydrate) with slight intermittent air jets or by capillarity. It is important to dry the enamel well and not to dehydrate the dentin;
8. Apply the bonding agent (a.e. Master Bond DE) according to manufacture's instructions;
9. Apply **MASTER FLOW** to fill the cavity as the initial layer (thickness min. 1 mm and max 2 mm);
10. Light Cure;
11. Place with composite (a.e. Master Fill), according to manufacturer's instructions.

II - Esthetics dental restorations:

1. Make the coronal polishing with pumice powder and water;
2. Accomplish the clinical procedures of cavity preparation according to required technique;
3. Select the shade with the tooth still moist;
4. Place rubber dam;
5. Apply the 37% Orthophosphoric Acid (a.e. Ataque Gel) during 15 seconds for dentin and 30 seconds for enamel;
6. Rinse thoroughly with water for 30 seconds;
7. Dry but do not dehydrate the dentin though soft airflow;

It is important to dry enamel but do not dehydrate Dentin;

8. Apply the bonding agent (a.e. Master Bond DE) according to manufacture's instruction;
9. Apply **MASTER FLOW** to fill the cavity in thin layers (thickness min. 1 mm and max 2 mm);
10. Light cure for 20 seconds;
11. Because of its viscosity (high glaze) final polishing is not necessary unless the occlusal or enamel adjustments are necessary.

III - Prosthesis repair and indirect restorations:

1. Carry out, if necessary, the masking of the metal by means of an opacifier (eg. Biocal);
2. Apply the Porcelain Conditioner for 4 minutes, rinse and dry;
3. Apply Silane all over the conditioned area and wait for one minute; apply new layer;
4. Apply bonding system (a.e. Master Bond DE) according to the manufacture's instruction;
5. Place **MASTER FLOW** fulfilling cavity in thin layers (thickness of min 1 max 2 mm);
6. Finish and polish.

SPECIAL CARES:

- Dentin pulp complex must be protect with an appropriate base before etching;
- Eugenol based liners affect negatively in polymerization;
- Discoloration can occur when cationic mouth rinse is used as well as bacterial plaque disclosing and chlorhexidine;
- To obtain a satisfactory light curing, high quality equipments must be used. The distance to restoration surface should be inferior to 5 mm when light curing: follow rigorously the instructions for thickness of restorative and light exposure time. Composites do not duly light cured can result a dentin pulp complex irritation, reducing the mechanical properties and discoloration.
- When working on extensive cases, change the position of the operating light to avoid the early composite set-up.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

SPECIAL RECOMMENDATION:

The use of a surface sealant (a.e. Bioforty) is recommended to raise the resistance and improve integrity margins restorations and conserve the brightness of the resin.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages.

STORAGE:

After using keep the syringes tightly closed to avoid exposure to the light.

Do not store the product near a product containing Eugenol. Eugenol interferes in polymerization.


CONTRAINDICATION:

MASTER FLOW should not be used on the impossibility to realize the absolute isolation. Should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed. Do not use material after expiry date.

WARNINGS:

The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions. "KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".

FOR USE IN DENTISTRY ONLY

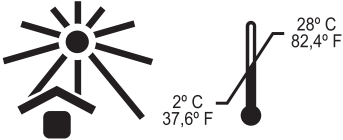

Conservar ao abrigo da luz solar em temperaturas entre 2 a 28 °C.



Biodinâmica Quím. e Farm. Ltda.
CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 Parque Industrial IV
86200-000 Ibioporã - Paraná - Brasil
Fone +55 43 3178-7000 Fax +55 43 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000



BDP - Biodinâmica Dental Products LDA.
Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305
Figueiró dos Vinhos - Portugal

MASTER FLOW

Resina Composta de Baixa Viscosidade Fotopolimerizável

biodinâmica®

APRESENTAÇÃO:

Kit Introdução:
3x2g seringas **MASTER FLOW** nas cores: A2 - A3,5 - OA2.
6 bicos aplicadores.

Reposição:
1x2g seringa **MASTER FLOW** disponível nas cores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 - B3 - C3 - OA2.
1 bico aplicador.

Reg. ANVISA: 10298550092.

COMPOSIÇÃO:

Matriz de Monômeros Metacrílicos, Carga Inorgânica, Iniciadores, Estabilizadores e Pigmentos.

INDICAÇÃO:

MASTER FLOW é uma resina indicada para restaurações dentárias estéticas definitivas anteriores ou posteriores como primeira aplicação (camada inicial) sob resinas compostas restauradoras (p.ex. Master Fill); para restaurações de microcavidades; para restaurações cervicais; para restaurações preventivas de resina em molares e pré-molares; para reparos em restaurações de compósitos e de cerâmica; para preenchimentos de socavados da estrutura dental; para cimentação adesiva de restaurações de compósito ou cerâmica; para splintagem de dentes com mobilidade, selamento de fôssulas e fissuras profundas; para colagem de fragmentos dentários.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:

MASTER FLOW é uma resina composta fotopolimerizável, híbrida e com micropartículas vitrocerâmicas modificadas organicamente, conferindo ao produto maior resistência, maior brilho, e menor contração de polimerização.

MASTER FLOW apresenta alta fluidez, proporciona acesso em microcavidades. É de fácil manuseio e não é solúvel no meio bucal. É compatível com todos os adesivos e resinas. Possui características radiopacas. O tempo de polimerização é de 20 segundos.

INSTRUÇÕES DE USO:

I - Em restaurações dentárias como camada inicial:

1. Promover o polimento coronário com pedra pomes e água;
2. Realizar o preparo cavitário de acordo com a técnica preconizada;
3. Selecionar a cor com dentes hidratados;
4. Realizar o isolamento absoluto;
5. Fazer o condicionamento ácido (p.ex. Ataque Gel) do esmalte por 30 segundos e da dentina por 15 segundos;
6. Lavar abundantemente com água a área condicionada por 30 segundos;
7. Secar a dentina (sem desidratar) com leves jatos de ar intermitentes ou por capilaridade. É importante secar bem o esmalte e não desidratar a dentina;
8. Usar o sistema adesivo (p.ex. Master Bond DE), seguindo as orientações do fabricante;
9. Aplicar **MASTER FLOW** para preencher locais socavados ou como primeira camada das restaurações, em camadas finas de 1mm e no máximo de 2mm de espessura;
10. Fotopolimerizar por 20 segundos;
11. Aplicar resina composta (p.ex. Master Fill), seguindo as orientações do fabricante.

II - Restaurações diretas:

1. Promover o polimento coronário com pedra pomes e água;
2. Realizar o preparo cavitário de acordo com a técnica preconizada;
3. Selecionar a cor com dentes hidratados;
4. Realizar o isolamento absoluto;
5. Fazer o condicionamento ácido (p.ex. Ataque Gel) do esmalte por 30 segundos, e da dentina por 15 segundos;
6. Lavar abundantemente com água a área condicionada por 30 segundos;
7. Secar a dentina (sem desidratar) com leves jatos de ar intermitentes ou por capilaridade. É importante secar bem o esmalte e não desidratar a dentina;
8. Usar o sistema adesivo (p.ex. Master Bond DE), seguindo as orientações do fabricante;

9. Aplicar **MASTER FLOW** preenchendo a cavidade a ser restaurada, em camadas finas de 1mm e no máximo 2mm de espessura;
10. Fotopolimerizar por 20 segundos;
11. Por ser uma resina fluida com alto brilho, não é necessário o polimento final, a não ser que ajustes de contorno ou oclusão necessitem ser realizados.
- III - Reparo de próteses e restaurações indiretas:
1. Realizar, se necessário, o mascaramento do metal por meio de um opacificador (p.ex. Biocal);
2. Para aumentar a adesão, aplicar o Condicionador de porcelana por 4 minutos lavar e secar;
3. Aplicar o Silano sobre a porcelana fraturada e aguardar 1 minuto; realizar nova aplicação;
4. Usar o sistema adesivo (p.ex. Master Bond DE), seguindo as orientações do fabricante;
5. Aplicar **MASTER FLOW** preenchendo a cavidade a ser restaurada, em camadas finas de 1mm e no máximo 2mm de espessura;
6. Realizar acabamento e polimento.

CUIDADOS ESPECIAIS:

- O complexo dentina-polpa deve ser protegido com base apropriada antes do condicionamento ácido.
- Forramentos à base de Eugenol influem negativamente no tempo de polimerização.
- O uso de colutórios catiônicos, evidenciadores de placas e clorexidina podem interferir na coloração do material.
- Para uma polimerização satisfatória utilizar fotopolimerizadores de qualidade adequada, e a distância para a polimerização da superfície da restauração, deve ser inferior a 5 mm; obedecer criteriosamente o tempo de exposição, assim como a espessura do material; resinas não polimerizadas adequadamente podem causar irritação ao complexo dentina-polpa, bem como reduz as propriedades mecânicas e provoca alteração.
- Em trabalhos demorados desviar a luz do refletor para evitar o endurecimento precoce do material.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS:

- Recomenda-se a aplicação de selante de superfície para restaurações (p.ex. Bioforty), para aumentar a resistência e melhorar a integridade das margens de restaurações e conservar o brilho da resina.
- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

CONSERVAÇÃO:

Após o uso deve ser observado o perfeito vedamento das seringas para evitar que o material seja exposto à luminosidade. Não armazenar em local próximo de produtos que contenham Eugenol, pois este interfere no tempo de polimerização.

CONTRAINDICAÇÃO:

MASTER FLOW é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”

USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

MASTER FLOW

Resina Compuesta Fotocurable de Baja Viscosidad

biodinâmica®

PRESENTACIÓN:

Kit Introducción:
3x2g jeringas **MASTER FLOW** en los colores: A2 - A3,5 - OA2.
6 puntas aplicadoras.
Reposición:

1x2g jeringa **MASTER FLOW** en los colores: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 - B3 - C3 - OA2.

1 punta aplicadora.

Reg. ANVISA : 10298550092.

COMPOSICIÓN:

Matriz de Monómeros Metacrílicos, Carga Inorgánica, Iniciadores, Estabilizadores y Pigmentos.

INDICACIÓN:

MASTER FLOW es indicado para la restauración dental estética definitiva anterior o posterior como primer uso (capa inicial), abajo de las resinas compuestas restauradoras (p.ej. Master Fill), para restauraciones en micro cavidades, cervicales, preventivas en molares y premolares, de cerámica, para la cementación adhesiva de la restauración de cerámica o compuesta, para enlazar fragmentos dentarios, para el splintage de dientes con movilidad y sellar fosas y fisuras profundas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

MASTER FLOW es una resina compuesta híbrida, fotopolimerizable, con micropartículas vitrocerámicas modificadas orgánicamente, que confieren al producto mayor resistencia, mayor brillo y menor contracción de polimerización.

MASTER FLOW presenta alta fluidez, proporciona acceso a microcavidades. Es fácil de manipular y no es soluble en el medio bucal. Es compatible con todos los adhesivos y resinas. Tiene características radiopacas.

El tiempo de polimerización es de 20 segundos.

INSTRUCCIONES DE USO:

I - Restauraciones dentarias estéticas definitivas (capa inicial):

1. Hacer el pulimento coronario con piedra pómez y agua;
2. Hacer el preparo de la cavidad de acuerdo con la técnica deseada;
3. Seleccionar el color con dientes hidratados;
4. Hacer el aislamiento absoluto (rubber dam);
5. Hacer el acondicionamiento ácido (p.ej. Ataque gel) del esmalte durante 30 segundos y de la dentina durante 15 segundos;
6. Lavar con mucha agua toda el área durante 30 segundos;
7. Secar la dentina (sin deshidratar) con ligeros chorros de aire intermitentes o por capilaridad. Es importante secar bien el esmalte y no deshidratar la dentina;
8. Aplicar el sistema adhesivo (p.ej. Master Bond DE) de acuerdo con las orientaciones del fabricante;
9. Aplicar **MASTER FLOW** como la primera camada de la restauración (capa inicial), en camadas delgadas de 1mm y máximo 2mm;
10. Fotocurar;
11. Aplicar la resina compuesta (p.ej. Master Fill) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

II - Restauraciones dentales estéticas:

1. Hacer el pulimento con piedra pómez y agua;
2. Hacer el preparo de la cavidad de acuerdo con la técnica deseada;
3. Seleccionar el color con dientes hidratados;
4. Hacer el aislamiento absoluto (rubber dam);
5. Hacer el acondicionamiento ácido (p.ej. Ataque gel) del esmalte durante 30 segundos y de la dentina durante 15 segundos;
6. Lavar con mucha agua toda el área durante 30 segundos;
7. Secar la dentina (sin deshidratar) con ligeros chorros de aire intermitentes o por capilaridad. Es importante secar bien el esmalte y no deshidratar la dentina;
8. Aplicar el sistema adhesivo (p.ej. Master Bond DE) de acuerdo con las orientaciones del fabricante;
9. Aplicar **MASTER FLOW** como la primera camada de la restauración (capa inicial), en camadas delgadas de 1mm y máximo 2mm;
10. Fotocurar durante 20 segundos;
11. Por tener características de grande brillo no es necesario el pulimento final.

III - Reparo de prótesis y restauraciones indirectas:

1. Realizar, si es necesario, el enmascaramiento del metal por medio de un opacificador (p.ej. Biocal);
2. Para aumentar la adhesión, aplicar el acondicionador de porcelana durante 4 minutos, lavar y secar;
3. Aplicar el Silano sobre la porcelana fraturada y aguardar 1 minuto; aplicar otra camada;
4. Usar el sistema adhesivo (p.ej. Master Bond DE), siguiendo las orientaciones del fabricante;
5. Aplicar **MASTER FLOW** llenando la cavidad a ser restaurada, en camadas delgadas de 1mm máximo 2mm;
6. Realización de acabado y pulido.

CUIDADOS ESPECIALES:

- El complejo dentina pulpa debe ser protegido con base apropiada antes del acondicionamiento ácido.
- Forraciones basadas en Eugenol influyen negativamente en el tiempo de polimerización.
- El uso de los colutorios catiónicos, evidenciadores de placas y clorhexidina pueden interferir en la coloración del material;
- Para una polimerización satisfactoria usar fotopolimerizadores de calidad adecuada, y la distancia para la polimerización de la superficie de la restauración debe ser inferior a 5 mm; obedecer criteriosamente el tiempo de exposición, así como la espesura del material; resinas no polimerizadas adecuadamente pueden causar irritación al complejo dentina pulpa, bien como reducir las propiedades mecánicas y provocar alteraciones.
- En trabajos demorados desviar la luz del reflector para evitar o endurecimiento precoz del material.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Recomendase la aplicación del sellante de superficie para restauraciones (p.ej. Bioforty), para aumentar la resistencia y mejorar la integridad de las márgenes de restauraciones y conservar el brillo de la resina.
- Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONSERVACIÓN:

Después de usar se debe hacer el perfecto cerramiento de las jeringas para evitar exposición a la luminosidad.

No almacenar cerca de productos que contienen Eugenol. El Eugenol interfiere en la polimerización.

CONTRAINDICACIÓN:

MASTER FLOW no debe ser usado en la imposibilidad de realizarse el islamiento absoluto.

Es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del período indicado de validez.

El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

MASTER FLOW

Light Cured Low Viscosity Composite

biodinâmica®

CONTENTS:

Introductory Kit:
3x2g syringes **MASTER FLOW** - shades: A2 - A3,5 - OA2.
6 application tips.

Reposition:
1x2g syringe **MASTER FLOW** - shades: A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 - B3 - C3 - OA2.
1 application tip.

Reg. ANVISA : 10298550092.

COMPOSITION:

Matrix of Methacrylic Monomers, Inorganic Load, Initiators, Stabilizers and Pigments.

INDICATION:

MASTER FLOW is a composite indicate for anterior or posterior definitive esthetic dental restoration as a first application (initial layer) under light cured composite (a.e. Master Fill); for micro-cavities restoration; for cervical restoration; for preventive restoration in premolar and molar teeth; for ceramic and composites restoration repairs; for dental structures fillings; for the adhesive cementing of ceramic or composite restoration; for splinting of teeth with mobility; for dental fragments bonding.

TECHNICAL INFORMATION:

MASTER FLOW is a light cured, hybrid composite resin with organically modified glass-ceramic microparticles, giving the product greater resistance, greater shine, and less light curing contraction.

MASTER FLOW

presents high fluidity, provides access into microcavities. It is easy to handle and is not soluble in the oral

Ofertas selecionadas especialmente para você. Confira!

[Home](#) > [Dentística e Estética](#) > [Resina Composta](#) > Kit Resina Master Flow - Biodinâmica

1/5



Kit Resina Master Flow - Biodinâmica

Resina Híbrida. Embalagem com 3 seringas de 2g cada, nas cores A2, A3,5 e OA2.

Cod. de Referência: 546514

★★★★★ (1)

R\$86,90

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

 **Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.

 **Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.

 **Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

Detalhes

- * Fotopolimerizável.
- * Resina composta, híbrida de alta fluidez.
- * Baixa viscosidade.
- * Possui características radiopacas.
- * Possibilita acesso a microcavidades devido suas propriedades.
- * Elevada resistência mecânica.
- * Alto brilho.
- * Baixa contração de polimerização.
- * Estabilidade de cor e durabilidade.
- * Proporciona fácil e versátil manuseio ao profissional.
- * Não é solúvel no meio bucal.
- * Compatibilidade com todos os adesivos e resinas.
- * Preenchimento máximo de espessura: 2mm.
- * Tempo de fotopolimerização: 20 segundos.
- * Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.
- * Registro ANVISA: 10298550092.

Aplicação

Informações Adicionais

Tire dúvidas sobre o produto

Este produto ainda não tem perguntas. Faça a primeira!

Fazer uma pergunta

Avaliações deste produto

4,0

- 5 estrelas
- 4 estrelas
- 3 estrelas
- 2 estrelas

- (0)
- (1)
- (8)
- (0)

100% recomendam este produto

Ordenar

Avaliar produto



Bom!

gostei!

Wellen 10/10/2017

 *Compra verificada*

 *Sim, recomendaria este produto a um amigo.*

 Útil? (-1)

Carregar mais avaliações

Copyright © 2023 - Todos os direitos reservados | www.dentalcremer.com.br | Dental Cremer | CNPJ: 14.190.675/0001-55 | Rua das Missões, 674 - 2º andar - Ponta Aguda - Blumenau - Santa Catarina - CEP 89051-001 | Autorizações de Funcionamento ANVISA - Medicamentos: 1.09.245-3, Produtos para Saúde (Correlatos): 8.08.576-8, 8.10.706-3, Saneantes Domissanitários: 3.05.135-4, Perfumes/Produtos de Higiene/Cosméticos: 2.06.387-3 | CNPJ: 14.190.675/0002-36 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 03 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutica responsável: Shirley de Toledo Ladislau - CRF/MG nº 11.607 | CNPJ: 14.190.675/0003-17 | Av. das Indústrias Antônio Conrado de Oliveira, 90 - Galpão 04 - Distrito Industrial - Itapeva - Minas Gerais - CEP 37655-000 - Farmacêutico responsável: Diego Diônata da Rosa - CRF/MG nº 31666. Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compra.

